



# JULGAMENTO RECURSO



**TERMO DE JULGAMENTO**  
**IMPUGNAÇÃO CONTRA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA:**  
**URSA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.628.908/0001-38**

**TERMO:** DECISÓRIO  
**FEITO:** RECURSO ADMINISTRATIVO  
**RECORRENTE:** ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  
**RECORRIDO:** PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE  
**REFERÊNCIA:** RECURSO CONTRA CLASSIFICAÇÃO  
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRONICO  
**Nº DO PROCESSO:** 10.003-2024/SRP  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE

**I – PRELIMINARES**

**A) DO CABIMENTO**

Trata-se de Recurso interposto pela empresa **ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** contra **CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA: URS COMERCIAL LTDA**.

Em tela.

De Imediato podemos destacar que a peça recursal é toda apresentada sem observância ao edital e documentação anexada. Mas em atenção ao princípio da ampla defesa, mesmo a peça encontrando-se sem observância aos documentos apresentados, mas apresentando outras formalidades mínimas exigidas no edital licitatório, contendo ainda o pedido pelo qual se pleiteia a demanda, mesmo não estando em consonância com as argumentações alegadas, vamos julgar o mérito.

**B) DA TEMPESTIVIDADE**

Inicialmente, cabe apreciar os requisitos de admissibilidade da referida impugnação, assim, averiguar o cumprimento quantos aos quesitos para propositura da presente demanda.

Na mesma toada, o Edital e a Lei da licitação regularam do seguinte modo: Recurso no prazo de 03 (três) dias úteis contra julgamento das propostas.

Conquanto, a licitante protocolou tal demanda, tendo a mesma cumprido tal requisito.

Assim, entende-se que a tempestividade foi cumprida, haja vista manifestação ordinária em afino às exigências requeridas.

Adentramos aos fatos.

**II – DOS FATOS**



Argui a impugnante em suas fundamentações que a proposta da Empresa **URSA COMERCIAL LTDA**, não poderia ter sido classificada, na oportunidade que aduziu:

A Pregoeira deixou de verificar que a Empresa vencedora não apresentou alguns documentos relativos à Habilitação: Certidão Específica da Junta Comercial, não apresentou certidão da ANVISA. Relativos à Proposta: Apresentou erros de unidades em alguns itens: item 6.4 apresentando modelo "Scope" e o fabricante possui modelos "Pen-Scope" e "E-Scope". Item 6.2 apresentou modelo "PC" e o fabricante possui modelos "PC-66B", "PC-900", "PC-303.

Requerendo também a reforma da decisão que declarou a Empresa recorrida vencedora.

Após diligências da Pregoeira, atendendo o que determina o art.64 da Lei14.133/2021, aonde frisa que na fase de habilitação serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. Ou seja, ainda que a habilitação seja prévia à apresentação das propostas, a regularidade fiscal só terá seus documentos exigidos após o julgamento. Foi o caso aqui em questão já que esta pregoeira julgou a habilitação da vencedora e verificou que não ocorreu nenhuma alteração na sua Certidão Específica após a última emissão em 30 de abril de 2024. Vale salientar que a parcela da habilitação, constituída em regularidade fiscal, só será analisada posteriormente e essa medida, por certo, amplia a competitividade esperada. Quanto a alegação da certidão da ANVISA e Inmetro as mesmas não foram solicitadas e a Empresa Vencedora apresentou o Registro da Vigilância Sanitária que autoriza a comercialização dos produtos aqui discutidos, portanto não encontramos nenhuma irregularidade.

Quanto as impugnações das propostas:

**Item 6.2 - "Modelo PC"** = Conforme análise das especificações técnicas do catálogo de itens referente à proposta do lote 6, item 6.2, todas as características estabelecidas no item, necessárias ao desempenho de suas funções, são atendidas. Portanto, a proposta cumpre com os requisitos técnicos exigidos no edital. Segundo parecer enviado pela secretária de saúde, após diligência da pregoeira.

**Item 6.4 - "Modelo Scope"** = Conforme análise das especificações técnicas do catálogo de itens referente à proposta do lote 6, item 6.4, e explicações do fornecedor, todas as características estabelecidas no item, necessárias ao desempenho de suas funções, são atendidas. Segundo parecer enviado pela secretária de saúde, após diligência da pregoeira.

Em síntese, são os fatos.

Passamos a análise de mérito.

### III - DO MÉRITO

A insurgência da impugnante **ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** faz menção ao não atendimento pela Empresa Recorrida no exigido em Edital, em alguns documentos relativos à Habilitação: não apresentou a Certidão Específica da Junta Comercial, não apresentou certidão da ANVISA. Relativos à Proposta: Apresentou erros de unidades em alguns itens: item



6.4 apresentando modelo "Scope" e o fabricante possui modelos "Pen-Scope" e "E-Scope". Item 6.2 apresentou modelo "PC" e o fabricante possui modelos "PC-66B", "PC-900", "PC-303.

Na oportunidade, após diligências da Pregoeira, a regularidade dos documentos exigidos após o julgamento fora analisada, quanto a Certidão específica não foi encontrada nenhuma irregularidade já que não ocorreu nenhuma alteração na sua Certidão Específica após a última emissão em **30 de abril de 2024**. Quanto a alegação da certidão da ANVISA e Inmetro as mesmas não foram solicitadas e a Empresa Vencedora apresentou o Registro da Vigilância Sanitária que autoriza a comercialização dos produtos aqui discutidos.

Cumpre esclarecer que o *processo licitatório tem por objetivos assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública*, a recorrente parte do falso pressuposto de que isso não foi cumprido. Importante destacar que todos os atos praticados por esta pregoeira, fundamenta-se na observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, tendo suas decisões fundamentadas em "estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos".

Quanto as impugnações das propostas:

Item 6.2 - "Modelo PC" = Conforme análise das especificações técnicas do catálogo de itens referente à proposta do lote 6, item 6.2, todas as características estabelecidas no item, necessárias ao desempenho de suas funções, são atendidas. Portanto, a proposta cumpre com os requisitos técnicos exigidos no edital.

Item 6.4 - "Modelo Scope" = Conforme análise das especificações técnicas do catálogo de itens referente à proposta do lote 6, item 6.4, e explicações do fornecedor, todas as características estabelecidas no item, necessárias ao desempenho de suas funções, são atendidas.

Conforme podemos observar, a Empresa vencedora apresentou sua **proposta** conforme exigido no Edital, **não existindo dúvidas quanto a confirmação que os preços estão exequíveis**. A licitação é um procedimento administrativo pelo qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para a contratação. O agente encarregado de julgar a licitação deve fiel observância à regra posta publicamente para a licitação, devendo se curvar-se ao denominado princípio da vinculação ao edital, e logicamente escolher a proposta mais vantajosa. Vale lembrar que o critério de julgamento utilizado nesta licitação, conforme prever o Edital é o **Menor Preço**.

Portanto, não existindo ilegalidade na sua habilitação e declaração de vencedora. E secundamente em atendimento ao princípio da economicidade expresso no art. 33, I da Lei 14.133/2021 que é a obtenção para a Administração Pública do menor custo possível, onde a empresa vencedora comprovou que o seu preço é o melhor exequível e mais perfeito em economicidade. E terceiromente buscando a celeridade no referido processo.

Portanto a proposta da Empresa recorrida foi a que apresentou o menor preço e, como tal, atendendo ao critério de julgamento, foi declarada vencedora.

Ante o exposto, defronte aos entendimentos legais e jurisprudenciais, não assista razão à empresa **ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**.



#### IV - DA DECISÃO

Vale ressaltar que a alegação técnica citada pela recorrente, foi respondida pela área técnica da Secretaria de Saúde, não cabendo a esta pregoeira o poder de decisão quanto ao fato recorrido. Diante de todo o exposto **CONHEÇO** do presente recurso realizado pela empresa **ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, haja vista o cumprimento do requisito preliminar de cabimento da peça e, de forma subjacente, no mérito **NEGAR PROVIMENTO**, no sentido de manter o processo licitatório **INALTERADO**.

É como decido.

Aracati/CE, 12 de julho de 2024.

*Natanielle Gondim Rodrigues*  
Natanielle Gondim Rodrigues

**Pregoeira da Secretaria de Licitações e Contratos Administrativos**

## Solicitação do catálogo referente ao lote 6 PE 10.003-2024/SRP

3 mensagens

**nataniele gondim** <nataniele.gondim@aracati.ce.gov.br>  
Para: ursaltda@gmail.com

3 de julho de 2024 às 15:21

Boa tarde. Senhor licitante, venho por meio deste, solicitar o catálogo correspondente ao lote 6, tendo em vista que a empresa concorrente entrou com recurso.

**Orbano** <orbano.ursa@gmail.com>  
Para: nataniele gondim <nataniele.gondim@aracati.ce.gov.br>

3 de julho de 2024 às 16:09

Boa tarde!

Em anexo nossos catálogos, Ficha.CATÁLOGOS.LT06.ARACATI.pdf

Envio também em anexo um pequeno demonstrativo, de fácil compreensão, no anexo Doc1, demonstrando os produtos que estão sendo oferecidos pela empresa que manifestou recurso, verá que nossos equipamentos são idênticos.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Obrigado,  
Orbano  
URSA COMERCIAL LTDA  
Equipamentos Médicos e Ortopédicos  
CNPJ 26.628.908/0001-38 INSC: 261.473.352  
E-mail: ursaltda@gmail.com  
Tel. Comercial (47) 9-9163.2802  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

### 2 anexos


 **Ficha.CATÁLOGOS LT06.ARACATI.pdf**  
1399K

 **Doc1.docx**  
916K

**nataniele gondim** <nataniele.gondim@aracati.ce.gov.br>  
Para: Orbano <orbano.ursa@gmail.com>

3 de julho de 2024 às 16:12

Recebido.  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

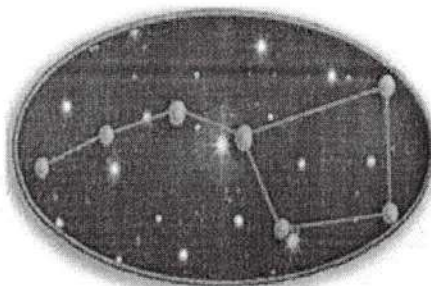**URSA COMERCIAL****URSA COMERCIAL LTDA.**

Equipamentos Médicos e ortopédicos.

CNPJ 26.628.908/0001-38

INSC: 261.473.352

E-mail: [ursaltda@gmail.com](mailto:ursaltda@gmail.com)

Telefone 47 9163-2802



oferece melhor acabamento e resistência estrutural ao conjunto. encosto oscilante, com movimentos reguláveis de afastamento e aproximação e longitudinal para apoio renal. assento com estofamento pouco espesso e bem consistente, formato anatômico com borda da frente arredondada e encurvada para baixo evita compressão de artérias, veias, nervos e tendões de músculos; totalmente sem costura ou emendas de fácil limpeza e desinfecção. altura do assento máxima de 540mm, mínima de 440mm. estofamento de cores suaves que dão maior integração com outros componentes do consultório.

Quantidade: 1,00	Valor Unit.: 404,00	Total Item: 404,00
------------------	---------------------	--------------------

LOTE 6	Total: R\$ 29.800,00
--------	----------------------

**VALOR TOTAL VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS**

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: CONTEC	Modelo: SB
---------	------------------	---------------	------------

Descrição: Doppler, tipo: sonnar portátil, elétrico, ausculta bcf por ultrassom, modelo: alta sensibilidade, c, auto-falante, som nítido, componentes: regulador volume, saída p, fone ouvido, tensão alimentação: 110,220 v, frequência: 60 hz

Quantidade: 10,00	Valor Unit.: 400,00	Total Item: 4.000,00
-------------------	---------------------	----------------------

Item: 2	Unidade: unidade	Marca: LEPU	Modelo: PC
---------	------------------	-------------	------------

Descrição: Analisador parâmetros equipamento saúde, funções: e simulador de oxímetro de pulso, parâmetros: saturação spo2, ritmo cardíaco, taxa perfusão, frequência: spo2 80 a 100%, 30 a 245 bpm, perfusão 0,2 a 10 %, características adicionais: tela lcd, controle stand alone, adicional 2: portátil, bateria recarregável

Quantidade: 3,00	Valor Unit.: 1.200,00	Total Item: 3.600,00
------------------	-----------------------	----------------------

Item: 3	Unidade: unidade	Marca: SAM MEDIC	Modelo: SM5004 INALOCLIN
---------	------------------	------------------	--------------------------

Descrição: Nebulizador, tipo: central mín.4 saídas, 4 fluxômetros, filtro, acessórios: 10 cj completos adulto e 10 pediátricos, tensão alimentação: 110,220 v, característica adicionais: compressor isento de óleo, 1,4hp

Quantidade: 7,00	Valor Unit.: 1.490,00	Total Item: 10.430,00
------------------	-----------------------	-----------------------

Item: 4	Unidade: unidade	Marca: RIESTER	Modelo: SCOPE
---------	------------------	----------------	---------------

Descrição: Oftalmoscópio, tipo: aço inox, tipo luz: luz anétrica, tensão alimentação: 2 pilhas médias v, características adicionais: disco de lentes de +, - 0,5 a +, - 20 dpt, aplicação: diafragma c, 2 tamanhos, componentes: e otoscópio c, cabeça\_c, lâmpada, regulador de luz, adicionais: visor móvel, 5 espéculos reutilizáveis

Quantidade: 22,00	Valor Unit.: 535,00	Total Item: 11.770,00
-------------------	---------------------	-----------------------

LOTE 7	Total: R\$ 5.250,00
--------	---------------------

**VALOR TOTAL CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS**

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PROLIFE	Modelo: PL
---------	------------------	----------------	------------

Descrição: Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo uso: locomoção possuir apoio (plástico pp) para os pés, individuais articulados, possuir apoio (plástico pp) para o braço, possuir assento em tecido de poliamida (nylon) preto, dobrável em x, possuir encosto em tecido de poliamida (nylon) preto, possuir eixos horizontais das rodas 6 polegadas com deslizamento em buchas, possuir eixos verticais direcionais (garfinhos) com deslizamento em bucha (aço), possuir estrutura tubular em aço carbono 3/4, possuir freios bilaterais tipo esticador, possuir punhos para condução em pvc preto, possuir rodas (plástico pp) direcionais com pneu maciço (pvc) de no mínimo 6 polegadas sendo direcionais atrás, possuir rodas (plástico pp) na frente com pneu maciço (pvc) de 6 polegadas. características adicionais: altura regulável, acessórios: suporte de soro.

Quantidade: 10,00	Valor Unit.: 525,00	Total Item: 5.250,00
-------------------	---------------------	----------------------

LOTE 20	Total: R\$ 110.054,00
---------	-----------------------

**VALOR TOTAL CENTO E DEZ MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS**

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: KONDENTECH	Modelo: YG100
---------	------------------	-------------------	---------------

Descrição: Amalgamador odontológico digital, frequência 60, tensão alimentação bivolt, modelo batedor de cápsula, acabamento liso e arredondado, tempo preparo de 0 30 seg. tipo movimento frequência movimento mínima 4000/elíptica, tamanho universal, modo de operação digital.

Quantidade: 4,00	Valor Unit.: 1.040,00	Total Item: 4.160,00
------------------	-----------------------	----------------------

Item: 2	Unidade: unidade	Marca: CLEONICE	Modelo: ION PRO X
---------	------------------	-----------------	-------------------


Descrição: Aparelho de raio x odontológico faixa de tensão kvp 01, instalação de parede, modo de operação analógico. braços arredondados: permite a unificação de peças. equilíbrio dinâmico preciso: permite estender todos os braços em linha reta, sem prejuízo da estabilidade de base. bloqueio contra disparos acidentais, evita disparos consecutivos. controle

Rua DR. PEDRO RANGEL N.577 SALA 05  
ITAJAÍ



BAIRRO SÃO JOÃO


CEP: 88.304-430  
SANTA CATARINA

# Detector Fetal Portátil/Mesa

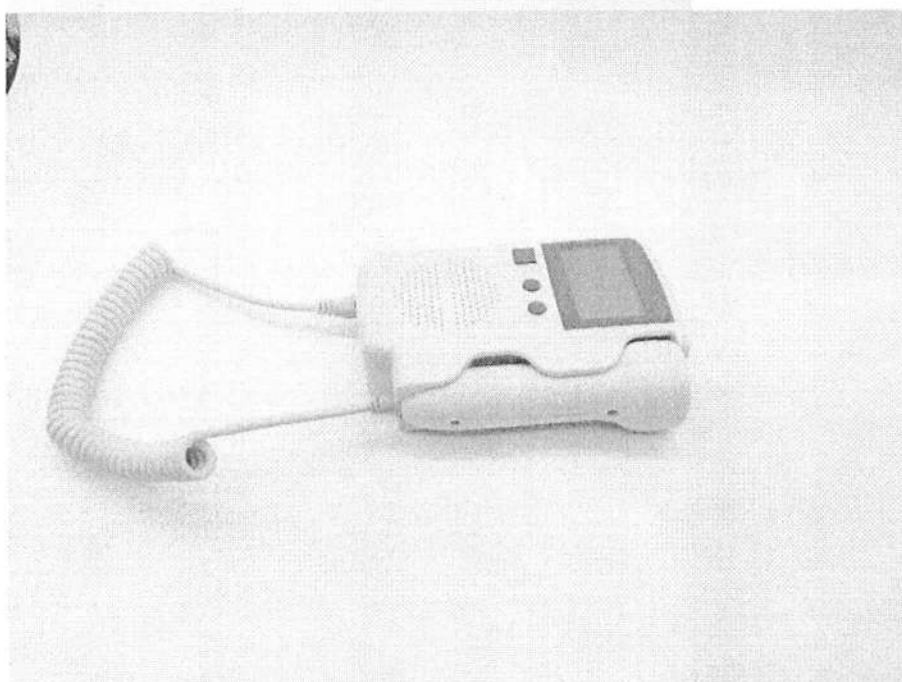



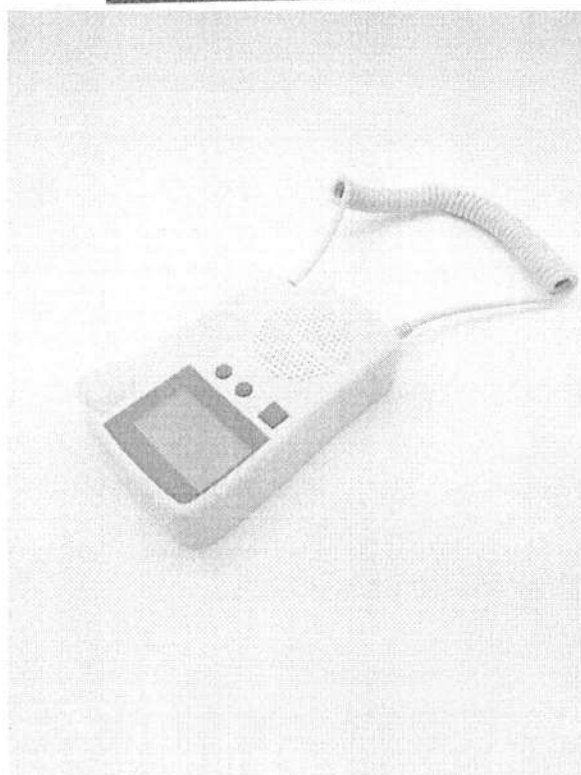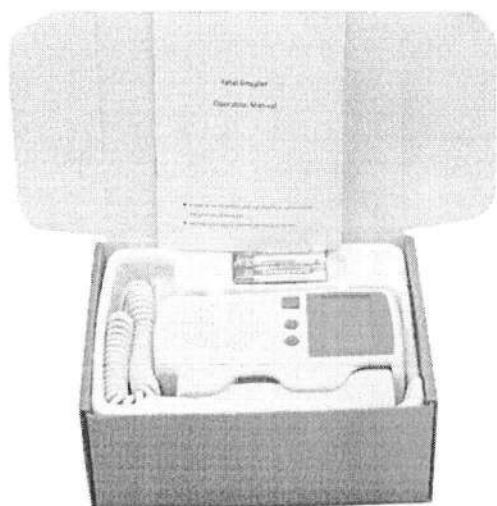

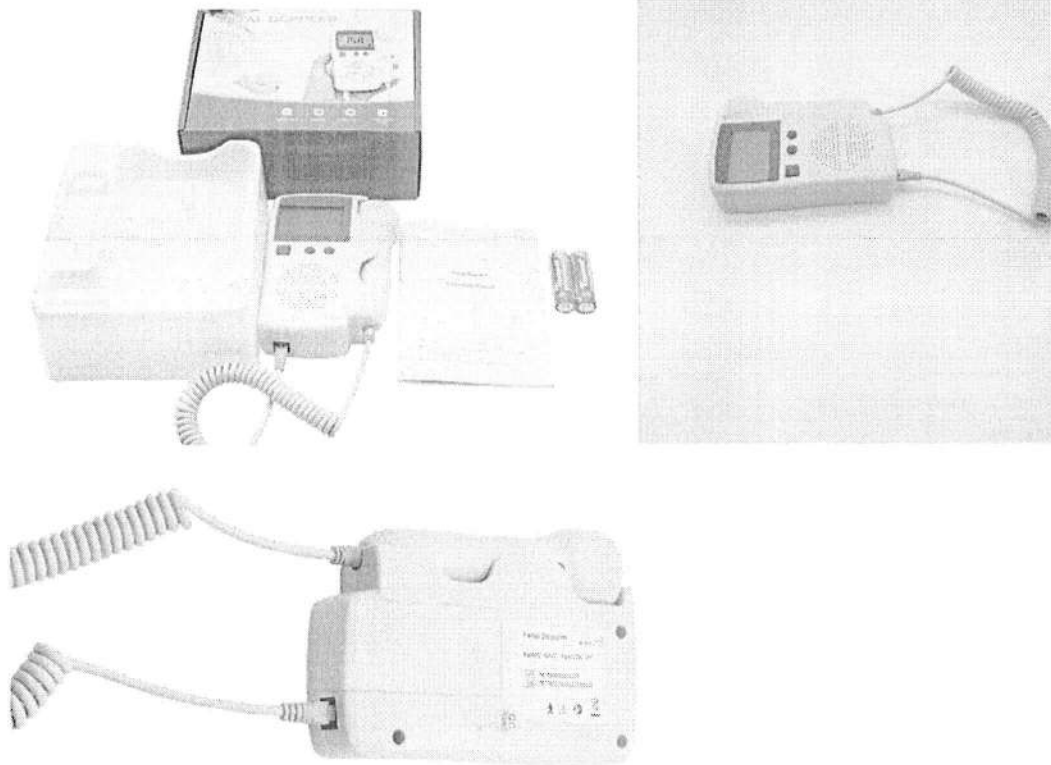

Descrição


## Detalhes

Operação simples e intuitiva;  
Proporciona excelente audição, com som de alta fidelidade;  
Permite audição através do fone de ouvido (fone não incluso) ou alto falante (embutido);  
Transdutor de alta sensibilidade;  
Display de LCD com 45x25 mm ;  
Ergonômico;  
Frequência do ultrassom de 2,5 MHz;  
Ultrassom de baixa intensidade: <math><10\text{mW/cm}^2</math>;  
Faixa de medida do BCF: 50~240bpm;  
Resolução do BCF de 1 bpm;  
Precisão do BCF de  $\pm 2\text{bpm}$ ;  
Acompanha:  
Manual em português

Dados técnicos:  
Peso: 100gramas  
Temperatura de Trabalho: 05° ~40°C  
Umidade: 15~85%  
Alimentação: Duas pilhas AA alcalinas ou recarregáveis  
Desligamento automático: Sim (após um minuto de inatividade)



\*Acessórios opcionais

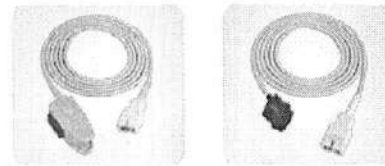

ANVISA: 80102519128



## Características

- Exibição da taxa de SpO2, frequência de pulso
- Visualização de PI, onda pletismografica e barra de pulso
- Tecnologia SPO2 anti movimento
- Para pacientes adultos, pediátricos e neonatais
- Bateria de lithium interna recarregável (sem efeito memória), com carregador integrado bivolt automático
- 384 horas de armazenamento de dados SpO2

- Limite de alarme, tons de tecla e nível de tom ajustáveis.
- Alarme audio visual de eletrodo desconectado
- Desligamento automático quando inativo
- Gráfico de tendências de SPO2 e BPM
- Software para comunicação com o PC
- Autonomia da bateria 18 horas

## Especificações técnicas

### SpO2

Cumprimento de onda duplo

Mensuração: 35% ~100%

Acurácia de medição:  $\pm 2\%$  ( para medição de 70% a 100%)

### Taxa de pulso

Medição: 30bpm ~250bpm

Acurácia de medição:  $\pm 2$ bpm ou  $\pm 2\%$

### Índice de Perfusão:

PI: 0.2% ~20%

Armazenamento de dados

Até 384 horas

### Display

2.2 TFT Display

### Opcionais

Outros modelos de sensores

### Fonte de Energia:

Bateria de lithium (opcional Pilhas AA)

### Carregamento

Cabo USB com adaptador

### Dimensões

145 mm x 74 mm x 29 mm

### Peso Líquido

210g

### Armazenamento de dados

Através de Cabo USB

### Acompanha

01 Sensor reutilizável Clip Adulto

Pedestal com cesto e rodízios

# NEBULIZADOR INALOCLIN



## APARELHO DE AEROSOL 04 SAÍDAS

Ecologicamente correto.

MARCA: INALOCLIN


MODELO SAM-5004

REGISTRO ANVISA: 82354539002

FABRICANTE: SAM MEDIC

PRODUTO: NACIONAL

Garantia Fabricante : 1 ano

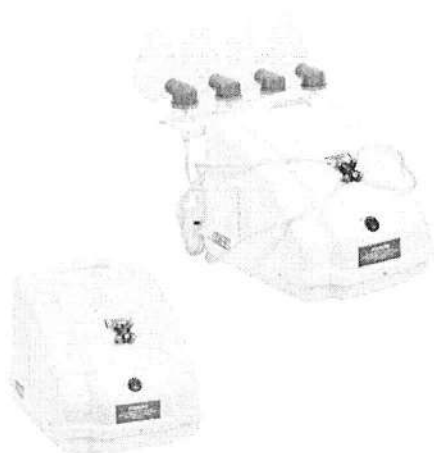

### Principais Opcionais



Fluxômetro  
de Oxigênio

Válvula reguladora de oxigênio, finalidade fornecer os dados de vazão dos gases em litros por minuto..



Timer Digital

Timer Digital Programável - Temporizador



Régua de impacto

Tomada de alunos para multiplicar saídas para oxigenoterapia modelos 1 saída e 10 saídas


### Especificações e Características Técnicas

MOTOR	1/4 (CV)
FLUXO DE AR	28 L/M
GRAU DE PROTEÇÃO	IP21
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127 OU 220V; 127/220V; 127-220V BIVOLT AUTOMÁTICO
MASCARA	KIT DE MICRO NEBULIZAÇÃO COMPLETO
PESO	5 KG
Frequência	60HZ
Dimensão	230 x 500 x 390

- Outros Opcionais
- Manômetro
- fluxômetros
- kits de nebulização completos adulto (compostos por: 01 copinho, 01 mangueira, 01 máscara adulta, 01 máscara)
- kits de nebulização completos infantil (compostos por: 01 copinho, 01 mangueira, 01 máscara adulta, 01 máscara)
- Outros Opcionais – Vide Manual Do Equipamento

**SAM MEDIC**  
EQUIPAMENTOS ELETROEQUIPAMENTOS




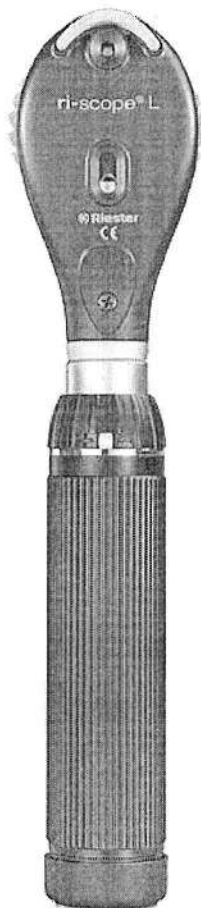

## Oftalmoscópios ri-scope® L

### Eficiência ecológica e iluminação e óticas avançadas

ri-scope® L – oftalmoscópios portáteis de topo, com óticas reconhecidas, menor reflexo e tecnologia LED para permitir um diagnóstico mais eficiente com custos de manutenção mais reduzidos. Disponível com iluminação de xénon ou LED e uma grande gama de opções de alimentação.

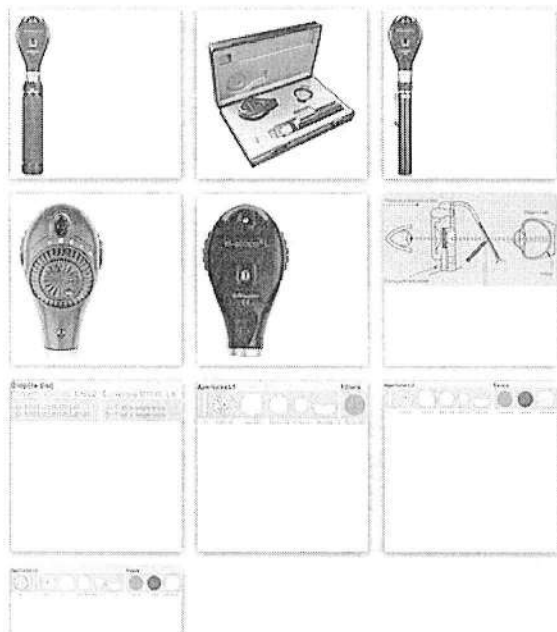

#### Product Details

#### Accessories

#### Downloads

#### Oftalmoscópios ri-scope®

##### ri-scope® L1

29 lentes; positivas (1-10, 12, 15, 20, 40); negativas (1-10, 15, 20, 25, 30, 35)  
 aberturas: ranhura, estrela de fixação, círculo grande, círculo médio, círculo pequeno, filtro sem vermelho

##### ri-scope® L2

29 lentes; positivas (1-10, 12, 15, 20, 40); negativas (1-10, 15, 20, 25, 30, 35)  
 aberturas: ranhura, estrela de fixação, círculo grande, círculo médio, círculo pequeno, filtro sem vermelho, filtro azul, filtro polarizador

##### ri-scope® L3

89 lentes; positivas (1-45 em incrementos individuais); negativas (1-44 em incrementos individuais)  
 aberturas: grelha, ranhura, estrela de fixação, círculo grande, círculo médio, círculo pequeno, filtro sem vermelho, filtro azul, filtro polarizador  
 dispositivo de focagem para correção rápida de ametropias

#### Óticas reconhecidas de alto desempenho e boa iluminação

lente condensadora esférica  
 Feixes de luz coaxiais para diagnóstico e iluminação (princípio de Gullstrand)  
 Vista com redução do reflexo, mesmo com pupilas pequenas

Desempenho de iluminação do LED de até 150.000 Lux

À prova de poeiras



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
<b>CNPJ</b>	66.581.935/0001-17	<b>Autorização</b>	8.01.530-3
<b>Produto</b>	DOPPLER FETAL DE BOLSO		

Modelo Produto Médico

SONOLINE B

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
-----------------	----------	-------------------------------------

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

<b>Nome Técnico</b>	Sistema Ultra-Sonico "doppler"
<b>Registro</b>	80153030105
<b>Processo</b>	25351.831662/2016-36
<b>Fabricante Legal</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>FABRICANTE: CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO, LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR</li></ul>
<b>Classificação de Risco</b>	II - MEDIO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

Voltar



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA		
<b>CNPJ</b>	04.718.143/0001-94	<b>Autorização</b>	8.01.025-1
<b>Produto</b>	Oxímetro de Pulso Portátil		

## Modelo Produto Médico

PC-66B

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU_80102519128.pdf	0227132/22-0 - 18/01/2022 - 08:46

<b>Nome Técnico</b>	Oxímetro de Pulso
<b>Registro</b>	80102519128
<b>Processo</b>	25351.035693/2021-35
<b>Fabricante Legal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FABRICANTE: LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING ) CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR</li> </ul>
<b>Classificação de Risco</b>	II - MEDIO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para PDF](#)
[Voltar](#)



## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ	21.983.850/0001-27
Autorização	8.23.545-3
Produto	nebulizador sam medic - inaloclin

Modelo Produto Médico
sam-5001
sam-5001-c
sam-5002
sam-5002-c
sam-5003
sam-5003-c
sam-5004
sam-5004-c
sam-5005
sam-5005-c
sam-5006
sam-5006-c
sam-5008-c
sam-5010-c

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL FAMÍLIA NEBULIZADOR SAM MEDIC - INALOCLIN - REV 01.pdf	4290420222 - 13/06/2022 16:08:21

Nome Técnico	Nebulizador
Registro	82354539002
Processo	25351024221202238
Fabricante Legal	SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]



Data de Publicação

[sem dados cadastrados]





## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	Halma Saúde e Ótica do Brasil Importação Exportação e Distribuição Ltda
CNPJ	13.640.053/0001-19
Autorização	8.08.916-2
Produto	OFTALMOSCÓPIO RIESTER

Modelo Produto Médico
2076.100 pen-scope oftalmoscópio lâmpada XL 2,5V
3011.100 ri-mini® oftalmoscópio lâmpada XL 2,5 V
2120-200.100 oftalmoscópio e-scope lâmpada à vácuo 2,7V cor branco
2121-200.100 oftalmoscópio e-scope lâmpada à vácuo 2,7V cor preto
2122-201.100 oftalmoscópio e-scope lâmpada XL 2.5 V, cor branco
2123-201.100 oftalmoscópio e-scope lâmpada XL 2.5 V, cor preto
2122-203.100 oftalmoscópio e-scope lâmpada LED 3.7 V cor branco
2123-203.100 oftalmoscópio e-scope lâmpada LED 3.7 V cor preto
10568.100 Oftalmoscópio ri-scope L1 XL 2,5V
10569.100 Oftalmoscópio ri-scope L1 XL 3,5V
10568-301.100 Oftalmoscópio ri-scope L1 lâmpada XL 2,5V com sistema anti-furto
10569-301.100 Oftalmoscópio ri-scope L1 lâmpada XL 3,5V com sistema anti-furto
10594-301.100 Oftalmoscópio ri-scope L1 lâmpada LED 3,5V com com sistema anti-furto
10569-203.100 Oftalmoscópio ri-scope L1 lâmpada XL 3,5V com com sistema anti-furto
10570.100 Oftalmoscópio ri-scope L2 lâmpada XL 2,5V
10571.100 Oftalmoscópio ri-scope L2 lâmpada XL 3,5V
10570-301.100 Oftalmoscópio ri-scope L2 lâmpada XL 2,5V com sistema anti-furto
10571-301.100 Oftalmoscópio ri-scope L2 lâmpada XL 3,5V com sistema anti-furto
10595-301.100 Oftalmoscópio ri-scope L2 lâmpada LED 3,5V com sistema anti-furto
10571-203.100 Oftalmoscópio ri-scope L2 lâmpada LED 3,5V
10572.100 Oftalmoscópio ri-scope L3 lâmpada XL 2,5V
10573.100 Oftalmoscópio ri-scope L3 lâmpada XL 3,5V
10572-301.100 Oftalmoscópio ri-scope L3 lâmpada XL 2,5V com sistema anti-furto
10573-301.100 Oftalmoscópio ri-scope L3 lâmpada XL 3,5V com sistema anti-furto
10573-203.100 Oftalmoscópio ri-scope L3 lâmpada LED 3,5V
10596-301.100 Oftalmoscópio ri-scope L3 lâmpada LED 3,5V com sistema antifurto



INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso_Oftalmo Riester Direto 80891620015.pdf	4133313208 - 23/11/2020 17:18:34

<b>Nome Técnico</b>	Oftalmoscópio
<b>Registro</b>	80891620015
<b>Processo</b>	25351602290201372
<b>Fabricante Legal</b>	RUDOLF RIESTER GMBH
<b>Classificação de Risco</b>	I - BAIXO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE
<b>Situação</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Data de Publicação</b>	[sem dados cadastrados]



Aracati, 03 de julho de 2024

OFÍCIO Nº 0307.02/2024

Excelentíssima Senhora CRISTIANE ARAÚJO VIEIRA ALVES, Secretária de saúde do Município de Aracati.

Pelo Presente, vimos encaminhar para esta Secretaria o Recurso Administrativo da empresa **ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**, sobre questionamentos referente aos itens **6.2** e **6.4** do lote 6, da proposta da empresa vencedora do Pregão Eletrônico nº 10.003-2024/SRP, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE. Segue questionamento** *"E ainda, o equipamento ofertado para o item 6.4 do lote 06, o licitante não demonstrou o atendimento do equipamento ao solicitado, devido a ter registrado em sua proposta apenas "modelo Scope", e o fabricante possui modelos "Pen-Scope" e "E-Scope", os quais possuem características distintas, o mesmo, se aplica ao item 6.2, onde o licitante informou modelo "PC", que o fabricante, possui PC-66B, PC-900, PC-303, entre outros, logo, a comissão não tem como identificar qual equipamento será entregue ao Município pelo licitante, qualquer um destes será o que o mesmo constou parcialmente em sua proposta. Logo o equipamento ofertado pelo licitante, classificado em primeiro, não atende ao contido em edital, sendo este inferior ao solicitado e o licitante não atendeu com a apresentação de todos os documentos de habilitação previstos em edital".* Foi solicitado da empresa vencedora catálogo com a descrição dos itens a serem entregues. Segue em anexo a proposta vencedora, recurso administrativo e catálogo da empresa declarada vencedora do lote. Como se trata de entendimento técnico, solicito que a secretária e/ou alguém do quadro técnico da secretaria emita um documento nos respondendo se os itens ofertados atendem ou não o Termo de referência.

Sem mais, elevo o meu voto de estima e consideração.

Nataniele Rodrigues Gondim

**Pregoeira da Secretaria de Licitações e Contratos Administrativos**

## PE 10.003-2024/SRP - Questionamento descritivo de item

1 mensagem

nataniele gondim <nataniele.gondim@aracati.ce.gov.br>

3 de julho de 2024 às 16:45

Para: fsaudearacati@aracati.ce.gov.br

Boa tarde, segue em anexo ofício solicitando que a Secretaria nos responda se os questionamentos levantados no recurso tem procedência ou não.


Em anexo: Proposta do lote 6; recurso administrativo e catálogo da empresa.

Grata!



### 4 anexos

 **IMG\_0003.pdf**  
1890K

 **recurso administrativo.pdf**  
1123K

 **Doc1.docx**  
915K

 **Ficha.CATÁLOGOS LT06.ARACATI.pdf**  
1418K



Of. N. 178/2024/SMS

Aracati, 11 de julho de 2024.

A Senhor,  
Nataniele Gondim Rodrigues  
Pregoeira do Município do Aracati

**Assunto:** Esclarecimentos referentes ao pregão eletrônico nº 10.003-2024/SRP.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste fornecer os esclarecimentos solicitados, em resposta às perguntas encaminhadas por e-mail a esta Secretaria, relativas ao Pregão Eletrônico nº 10.005/2024:

Item 6.2 – “Modelo PC”

Recurso:

A empresa Asclépio questiona as especificações técnicas do item 6.2, modelo "PC".

Descrição/Especificação Técnica do Item Licitado: ANALISADOR PARÂMETROS EQUIPAMENTO SAÚDE, FUNÇÕES: E SIMULADOR DE OXÍMETRO DE PULSO, PARÂMETROS: SATURAÇÃO SPO2, RITMO CARDÍACO, TAXA PERFUSÃO, FREQUÊNCIA: SPO2 80 A 100%, 30 A 245 BPM, PERFUSÃO 0,2 A 10 %, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TELA LCD, CONTROLE STAND ALONE, ADICIONAL 2: PORTÁTIL, BATERIA RECARREGÁVEL.

Especificações Técnicas do Catálogo de Itens do Lote 6:

Modelo: OXÍMETRO DE PULSO PC-66B

Exibição da taxa de SPO2

SPO2: Acurácia de Medição:  $\pm 2\%$  (para medição de 70% a 100%)

Taxa de Pulso: Medição: 30BPM ~250BPM

PI: 0.2% ~20%

Características Adicionais: Bateria de Lithium (opcional pilhas AA), Tela de LCD, 01 Sensor Reutilizável Clip Adulto.

Conclusão: Conforme análise das especificações técnicas do catálogo de itens referente à proposta do lote 6, item 6.2, todas as características estabelecidas no item, necessárias ao desempenho de suas funções, são atendidas. Portanto, a proposta cumpre com os requisitos técnicos exigidos no edital.

Item 6.4 – “Modelo Scope”

Recurso:

A empresa Asclépio questiona as especificações técnicas do item 6.4, modelo "Scope".

Descrição/Especificação Técnica do Item Licitado: OFTALMOSCÓPIO, TIPO: AÇO INOX, TIPO LUZ: LUZ ANÉTRICA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS MÉDIAS V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISCO DE LENTES DE +, - 0,5 A +, - 20 DPT, APLICAÇÃO: DIAFRAGMA C, 2 TAMANHOS, COMPONENTES: E OTOSCÓPIO C, CABEÇA C, LÂMPADA, REGULADOR DE LUZ, ADICIONAIS: VISOR MÓVEL, 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS.




Especificações Técnicas do Catálogo de Itens do Lote 6:

Oftalmoscópio: Lâmpada de xênon 2,5V, regulador de luz, lentes de 0 a +20 e de 0 a -20 dioptrias, Display iluminado, quatro aberturas, acompanha 10 espéculos reutilizáveis, estrutura em aço, alimentação por duas pilhas.

Conclusão: Conforme análise das especificações técnicas do catálogo de itens referente à proposta do lote 6, item 6.4, e explicações do fornecedor, todas as características estabelecidas no item, necessárias ao desempenho de suas funções, são atendidas.

Atenciosamente,




---

Cristiane Araújo Vieira Alves  
Secretária da Saúde do Aracati



\*Acessórios opcionais

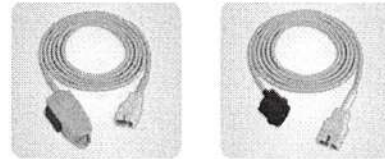

ANVISA: 80102519128



## Características

- Exibição da taxa de SpO<sub>2</sub>, frequência de pulso
- Visualização de PI, onda pletoisomográfica e barra de pulso
- Tecnologia SPO<sub>2</sub> anti movimento
- Para pacientes adultos, pediátricos e neonatais
- Bateria de lithium interna recarregável (sem efeito memória), com carregador integrado bivolt automático
- 384 horas de armazenamento de dados SpO<sub>2</sub>

- Limite de alarme, tons de tecla e nível de tom ajustáveis.
- Alarme audio visual de eletrodo desconectado
- Desligamento automático quando inativo
- Gráfico de tendências de SPO<sub>2</sub> e BPM
- Software para comunicação com o PC
- Autonomia da bateria 18 horas

## Especificações técnicas

### SpO<sub>2</sub>

Cumprimento de onda duplo

Mensuração: 35% ~100%

Acurácia de medição: ±2% ( para medição de 70% a 100%)

### Taxa de pulso

Medição: 30bpm ~250bpm

Acurácia de medição: ±2bpm ou ±2%

### Índice de Perfusão:

PI: 0.2% ~20%

Armazenamento de dados

Até 384 horas

### Display

2.2 TFT Display

### Opcionais

Outros modelos de sensores

### Fonte de Energia:

Bateria de lithium (opcional Pilhas AA)

### Carregamento

Cabo USB com adaptador

### Dimensões

145 mm x 74 mm x 29 mm

### Peso Líquido

210g

### Armazenamento de dados

Através de Cabo USB

### Acompanha

01 Sensor reutilizável Clip Adulto

Pedestal com cesto e rodízios



ri-mini®



## Otoscópios, Oftalmoscópios de Bolso

### Otoscópio

Lâmpada de xênon 2,5V, estrutura em plástico rígido reforçado com fibra de vidro, transmissão da luz através de fibra óptica, lente de aumento 2,5 vezes, sistema selado para otoscopia pneumática, lente removível para instrumentação, cabo de metal cromado resistente à corrosão.

Acompanha 10 espéculos reutilizáveis e autoclaváveis, 2 de cada tamanho: 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm e 5mm.

### Código

3010.100 ri-mini® otoscópio XL 2,5V, preto



D\* 1 2 3 4 6 10 15 20  
R\* 1 2 3 4 6 10 15 20

### Oftalmoscópio

Sistema de encaixe rápido e seguro no cabo. Altamente resistente à impactos. Estrutura em plástico rígido reforçado com fibra de vidro. Lâmpada fácil de trocar na base do instrumento em 2,5V. Lentes de 0 a +20 e de 0 a -20 dioptrias. Display iluminado, protetor para não arranhar a lente dos óculos. Quatro aberturas: círculo pequeno, semi-círculo, círculo grande e fixação, e um filtro verde.

### Código

3011.100 ri-mini® oftalmoscópio XL 2,5 V, preto

2 anos de garantia.

pen-scope®



D\* 1 2 3 4 6 10 15 20  
R\* 1 2 3 4 6 10 15 20

### Otoscópio pen-scope

Agora com lâmpada 2,7 V a vácuo, lente de aumento 2,5 vezes, sistema selado para otoscopia pneumática, lente removível para instrumentação. Estrutura em plástico rígido reforçado com fibra de vidro. Acompanha 10 espéculos reutilizáveis e autoclaváveis, 2 de cada tamanho: 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm e 5mm.

### Código

2056-200.100 pen-scope® otoscópio 2,7 V a vácuo, preto.

### Oftalmoscópio pen-scope

Possui agora lâmpada em xênon de 2,5 V XL. Lentes de 0 a +20 e de 0 a -20, display de dioptrias iluminado, proteção para os óculos, quatro aberturas (círculo pequeno, semi-círculo, círculo grande e fixação). Estrutura em plástico rígido reforçado com fibra de vidro.

### Código

2076.100 pen-scope® oftalmoscópio 2,5 V XL, preto, em bolsa.

2 anos de garantia.



Aracati, 03 de julho de 2024

OFÍCIO Nº 0307.02/2024


Excelentíssima Senhora CRISTIANE ARAÚJO VIEIRA ALVES, Secretária de saúde do Município de Aracati.

Pelo Presente, vimos encaminhar para esta Secretaria o Recurso Administrativo da empresa **ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**, sobre questionamentos referente aos itens **6.2** e **6.4** do lote 6, da proposta da empresa vencedora do Pregão Eletrônico nº 10.003-2024/SRP, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE. Segue questionamento** "E ainda, o equipamento ofertado para o item 6.4 do lote 06, o licitante não demonstrou o atendimento do equipamento ao solicitado, devido a ter registrado em sua proposta apenas "modelo Scope", e o fabricante possui modelos "Pen-Scope" e "E-Scope", os quais possuem características distintas, o mesmo, se aplica ao item 6.2, onde o licitante informou modelo "PC", que o fabricante, possui PC-66B, PC-900, PC-303, entre outros, logo, a comissão não tem como identificar qual equipamento será entregue ao Município pelo licitante, qualquer um destes será o que o mesmo constou parcialmente em sua proposta. Logo o equipamento ofertado pelo licitante, classificado em primeiro, não atende ao contido em edital, sendo este inferior ao solicitado e o licitante não atendeu com a apresentação de todos os documentos de habilitação previstos em edital". Foi solicitado da empresa vencedora catálogo com a descrição dos itens a serem entregues. Segue em anexo a proposta vencedora, recurso administrativo e catálogo da empresa declarada vencedora do lote. Como se trata de entendimento técnico, solicito que a secretária e/ou alguém do quadro técnico da secretaria emita um documento nos respondendo se os itens ofertados atendem ou não o Termo de referência.

Sem mais, elevo o meu voto de estima e consideração.

Nataniele Rodrigues Gondim

Pregoeira da Secretaria de Licitações e Contratos Administrativos

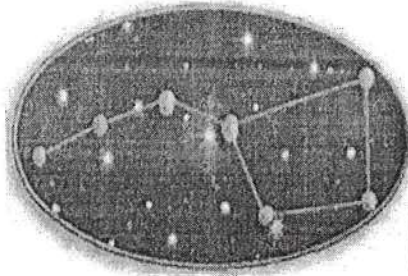**URSA COMERCIAL****URSA COMERCIAL LTDA.**

Equipamentos Médicos e ortopédicos

CNPJ 26.628.908/0001-38

INSC: 261.473.352

E-mail: [ursaltda@gmail.com](mailto:ursaltda@gmail.com)

Telefone 47 9163-2802



oferece melhor acabamento e resistência estrutural ao conjunto. encosto oscilante, com movimentos reguláveis de afastamento e aproximação e longitudinal para apoio renal. assento com estofamento pouco espesso e bem consistente, formato anatômico com borda da frente arredondada e encurvada para baixo evita compressão de artérias, veias, nervos e tendões de músculos; totalmente sem costura ou emendas de fácil limpeza e desinfecção. altura do assento máxima de 540mm, mínima de 440mm. estofamento de cores suaves que dão maior integração com outros componentes do consultório.

Quantidade: 1,00	Valor Unit.: 404,00	Total Item: 404,00
------------------	---------------------	--------------------

LOTE 6	Total: R\$ 29.800,00		
VALOR TOTAL VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS			
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: CONTEC	Modelo: SB
Descrição: Doppler, tipo: sonnar portátil, elétrico, ausculta bcf por ultrassom, modelo: alta sensibilidade, c, auto-falante, som nítido, componentes: regulador volume, saída p, fone ouvido, tensão alimentação: 110,220 v, frequência: 60 hz			
Quantidade: 10,00	Valor Unit.: 400,00	Total Item: 4.000,00	
Item: 2	Unidade: unidade	Marca: LEPU	Modelo: PC
Descrição: Analisador parâmetros equipamento saúde, funções: e simulador de oxímetro de pulso, parâmetros: saturação spo2, ritmo cardíaco, taxa perfusão, frequência: spo2 80 a 100%, 30 a 245 bpm, perfusão 0,2 a 10 %, características adicionais: tela lcd, controle stand alone, adicional 2: portátil, bateria recarregável			
Quantidade: 3,00	Valor Unit.: 1.200,00	Total Item: 3.600,00	
Item: 3	Unidade: unidade	Marca: SAM MEDIC	Modelo: SM5004 INALOCLIN
Descrição: Nebulizador, tipo: central mín.4 saídas, 4 fluxômetros, filtro, acessórios: 10 cj completos adulto e 10 pediátricos, tensão alimentação: 110,220 v, característica adicionais: compressor isento de óleo, 1,4hp			
Quantidade: 7,00	Valor Unit.: 1.490,00	Total Item: 10.430,00	
Item: 4	Unidade: unidade	Marca: RIESTER	Modelo: SCOPE
Descrição: Oftalmoscópio, tipo: aço inox, tipo luz: luz anétrica, tensão alimentação: 2 pilhas médias v, características adicionais: disco de lentes de +, - 0,5 a +, - 20 dpt, aplicação: diafragma c, 2 tamanhos, componentes: e otoscópio c, cabeça_c, lâmpada, regulador de luz, adicionais: visor móvel, 5 espelhos reutilizáveis			
Quantidade: 22,00	Valor Unit.: 535,00	Total Item: 11.770,00	

LOTE 7	Total: R\$ 5.250,00		
VALOR TOTAL CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS			
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PROLIFE	Modelo: PL
Descrição: Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo uso: locomoção possuir apoio (plástico pp) para os pés, individuais articulados, possuir apoio (plástico pp) para o braço, possuir assento em tecido de poliamida (nylon) preto, dobrável em x, possuir encosto em tecido de poliamida (nylon) preto, possuir eixos horizontais das rodas 6 polegadas com deslizamento em buchas, possuir eixos verticais direcionais (garfinhos) com deslizamento em bucha (aço), possuir estrutura tubular em aço carbono 3/4, possuir freios bilaterais tipo esticador, possuir punhos para condução em pvc preto, possuir rodas (plástico pp) direcionais com pneu maciço (pvc) de no mínimo 6 polegadas sendo direcionais atrás, possuir rodas (plástico pp) na frente com pneu maciço (pvc) de 6 polegadas. características adicionais: altura regulável, acessórios: suporte de soro.			
Quantidade: 10,00	Valor Unit.: 525,00	Total Item: 5.250,00	

LOTE 20	Total: R\$ 110.054,00		
VALOR TOTAL CENTO E DEZ MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS			
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: KONDENTECH	Modelo: YG100
Descrição: Amalgamador odontológico digital, frequência 60, tensão alimentação bivolt, modelo bater de cápsula, acabamento liso e arredondado, tempo preparo de 0 30 seg. tipo movimento frequência movimento mínima 4000/eliptcia, tamanho universal, modo de operação digital.			
Quantidade: 4,00	Valor Unit.: 1.040,00	Total Item: 4.160,00	
Item: 2	Unidade: unidade	Marca: CLEONICE	Modelo: ION PRO X
Descrição: Aparelho de raio x odontológico faixa de tensão kvp 01, instalação de parede, modo de operação analógico. braços arredondados: permite a unificação de peças. equilíbrio dinâmico preciso: permite estender todos os braços em linha reta, sem prejuízo da estabilidade de base. bloqueio contra disparos acidentais, evita disparos consecutivos. controle			

Rua DR. PEDRO RANGEL N.577 SALA 05  
ITAJAÍ

BAIRRO SÃO JOÃO

CEP: 88.304-430  
SANTA CATARINA