



# CONTRARRAZÃO



**URSA COMERCIAL**

**URSA COMERCIAL LTDA.**

Equipamentos Médicos e ortopédicos

CNPJ 26.628.908/0001-38

INSC: 261.473.352

E-mail: [ursaltda@gmail.com](mailto:ursaltda@gmail.com)

Telefone 47 9163-2802



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI – CE

Setor de Licitação

PREGOEIRO(A): SR(A). NATANIELE GONDIM RODRIGUES

E-mail: [nataniele.gondim@aracati.ce.gov.br](mailto:nataniele.gondim@aracati.ce.gov.br) ou via telefone (88) 3421-1050/ (88) 3421-1945|

Av. Dragão do Mar, 230, Centro, CEP: 62800-000 - ARACATI – CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.003-2024

Processo administrativo Nº 10.003-2024/SRP

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

### CONTRARRAZÃO AO RECURSO ADMINISTRATIVO

URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ 26.628.908/001- 38, com sede na Rua Doutor Pedro Rangel, 577, Sala 5 – Itajaí – SC, vem por meio desta apresentar CONTRARRAZÃO em virtude do RECURSO interposto pela empresa ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, já qualificada no certame licitatório epigrafado, em função dos fatos e do direito a seguir:

#### DO RECURSO APRESENTADO:

A recorrente apresentou recurso contra habilitação em face da recorrida, aduzindo, em síntese que a recorrida não atendeu aos requisitos do edital por:

“Manifestamos a intenção de recurso, o equipamento ofertado não atende ao solicitado em edital, detalharemos na peça recursal.”

Tal recurso não merece prosperar.

#### DO MÉRITO

Inicialmente, há que se destacar que as alegações da ora recorrente são meramente protelatórias ao processo, vejamos:

1 – ALEGA QUE NÃO ANEXAMOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme abaixo:

Em observância aos documentos de habilitação apresentados pelo licitante ora declarado vencedor, podemos verificar a ausência de alguns documentos solicitado em edital, para que os licitantes fossem declarados vencedor:


a.9) CERTIDÃO ESPECÍFICA DA JUNTA COMERCIAL, emitida em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura da proposta de preços deste certame

7

Rua DR. PEDRO RANGEL N.577 SALA 05  
ITAJAÍ

BAIRRO SÃO JOÃO

CEP: 88.304-430  
SANTA CATARINA

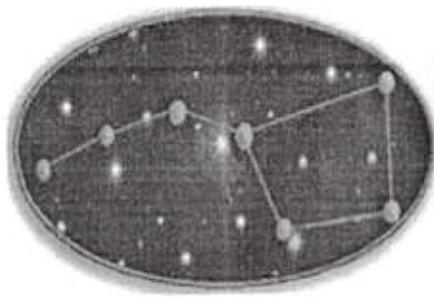

**URSA COMERCIAL**

**URSA COMERCIAL LTDA.**

Equipamentos Médicos e ortopédicos

CNPJ 26.628.908/0001-38

INSC: 261.473.352

E-mail: [ursaltda@gmail.com](mailto:ursaltda@gmail.com)

Telefone 47 9163-2802



Comprovamos que tal alegação não procede pois nossa CERTIDÃO ESPECÍFICA DA JUNTA COMERCIAL esta juntada aos autos, FOLHA 107, EM DOCUMENTOS DO PARTICIPANTE, ANTES DA DISPUTA, conforme abaixo:

### Documentos do participante

Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ: Fichário.ARACATI, proposta, balanço 2022-2023, docs gerais.pdf 18/06/2024 11:40



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

### CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE
Nome: RAIMUNDO MILEO GOMES
CPF/CNPJ: 252.393.468-01
Email: <a href="mailto:setaassessoriac@gmail.com">setaassessoriac@gmail.com</a>
DADOS DA EMPRESA
Nome: URSA COMERCIAL LTDA
NIRE: 42206914207

ARQUIVAMENTO SOLICITADO


E INSERIMOS NOVAMENTE PÓS-DISPUTA:

Classificação	Documentos Complementares									
Classificados										
	<table border="1"><thead><tr><th>Nome do arquivo</th><th>Upload em</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>ARACATI PE10.003-24.pdf</td><td>19/06/2024 16:00</td><td></td></tr><tr><td>Fichário.18.06.balancos 2022-2023, docs. gerais.pdf</td><td>19/06/2024 17:00</td><td></td></tr></tbody></table>	Nome do arquivo	Upload em		ARACATI PE10.003-24.pdf	19/06/2024 16:00		Fichário.18.06.balancos 2022-2023, docs. gerais.pdf	19/06/2024 17:00	
Nome do arquivo	Upload em									
ARACATI PE10.003-24.pdf	19/06/2024 16:00									
Fichário.18.06.balancos 2022-2023, docs. gerais.pdf	19/06/2024 17:00									
	<p>Upload</p> <p>Baixar tudo</p>									

Rua DR. PEDRO RANGEL N.577 SALA 05  
ITAJAÍ

BAIRRO SÃO JOÃO

CEP: 88.304-430  
SANTA CATARINA

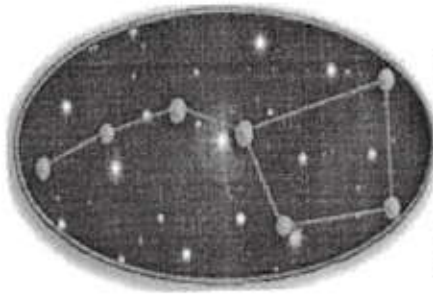

**URSA COMERCIAL**

**URSA COMERCIAL LTDA.**

Equipamentos Médicos e ortopédicos

CNPJ 26.628.908/0001-38

E-mail: [ursaltda@gmail.com](mailto:ursaltda@gmail.com)

INSC: 261.473.352

Telefone 47 9163-2802



Quanto às alegações de que nossa proposta não contempla número de Registro em órgão competente, O EDITAL É CLARO QUANTO AO "QUANDO FOR O CASO", e se fosse este "O CASO" conforme o próprio edital prevê o Art. 29:

**29.0 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

...

29.4- O Pregoeiro ou à Autoridade Superior, facultativamente, poderá em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofelado, bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. (grifo nosso)

**DESTACAMOS AINDA O QUE DIZ O EDITAL:**

...

"29.7-O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público."

Ocorre da presente manifestação de recurso simplesmente o fato da insatisfação da concorrente que, descontente com o resultado busca atrapalhar o processo com alegações pífias.

Outro fato importante a ser destacado é que temos plena ciência dos equipamentos que estamos oferecendo, tanto é que afirmamos para que possamos participar da disputa.

Assim, dada a ausência de irregularidades, pugna-se por seu improvimento, adjudicando o objeto à requerida.

Caso Vossas Senhorias não acatem as alegações descritas, pleiteamos, respeitosamente, que faça subir o presente recurso, devidamente informada, a Ilma. Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal, a quem é dirigido.

ITAJAÍ-SC, 01/07/2024

**RAIMUNDO MILEO GOMES**  
Sócio - Gerente  
RG. 12.647.524-6/SSP-SP  
CPF 252.393.468-01

Rua DR. PEDRO RANGEL N.577 SALA 05  
ITAJAÍ

BAIRRO SÃO JOÃO

**26.628.908/0001-38**

URSA COMERCIAL LTDA.- ME

Rua Dr. Pedro Rangel, 577 Sala 05  
São João - CEP 88.304-430

ITAJAÍ - SC

CEP: 88.304-430  
SANTA CATARINA

## Solicitação do catálogo referente ao lote 6 PE 10.003-2024/SRP

3 mensagens

**nataniele.gondim** <nataniele.gondim@aracati.ce.gov.br>  
Para: ursaltda@gmail.com

3 de julho de 2024 às 15:21

Boa tarde. Senhor licitante, venho por meio deste, solicitar o catálogo correspondente ao lote 6, tendo em vista que a empresa concorrente entrou com recurso.

**Orbano** <orbano.ursa@gmail.com>  
Para: nataniele.gondim <nataniele.gondim@aracati.ce.gov.br>

3 de julho de 2024 às 16:09

Boa tarde!

Em anexo nossos catálogos, Ficha.CATÁLOGOS.LT06.ARACATI.pdf

Envio também em anexo um pequeno demonstrativo, de fácil compreensão, no anexo Doc1, demonstrando os produtos que estão sendo oferecidos pela empresa que manifestou recurso, verá que nossos equipamentos são idênticos.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Obrigado,  
Orbano  
URSA COMERCIAL LTDA  
Equipamentos Médicos e Ortopédicos  
CNPJ 26.628.908/0001-38 INSC: 261.473.352  
E-mail: ursaltda@gmail.com  
Tel. Comercial (47) 9-9163.2802  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

### 2 anexos


 **Ficha.CATÁLOGOS LT06.ARACATI.pdf**  
1399K

 **Doc1.docx**  
916K

**nataniele.gondim** <nataniele.gondim@aracati.ce.gov.br>  
Para: Orbano <orbano.ursa@gmail.com>

3 de julho de 2024 às 16:12

Recebido.  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

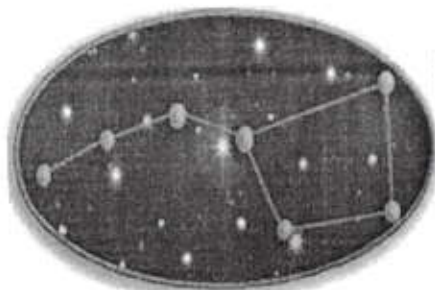

# URSA COMERCIAL

## URSA COMERCIAL LTDA.

Equipamentos Médicos e ortopédicos

CNPJ 26.628.908/0001-38

E-mail: [ursaltda@gmail.com](mailto:ursaltda@gmail.com)

INSC: 261.473.352

Telefone 47 9163-2802



oferece melhor acabamento e resistência estrutural ao conjunto, encosto oscilante, com movimentos reguláveis de afastamento e aproximação e longitudinal para apoio renal. assento com estofamento pouco espesso e bem consistente, formato anatômico com borda da frente arredondada e encurvada para baixo evita compressão de artérias, veias, nervos e tendões de músculos; totalmente sem costura ou emendas de fácil limpeza e desinfecção. altura do assento máxima de 540mm, mínima de 440mm. estofamento de cores suaves que dão maior integração com outros componentes do consultório.

Quantidade: 1,00 Valor Unit.: 404,00 Total Item: 404,00

LOTE 6 Total: R\$ 29.800,00

VALOR TOTAL VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS

Item: 1 Unidade: unidade Marca: CONTEC Modelo: SB

Descrição: Doppler, tipo: sonnar portátil, elétrico, ausculta bcf por ultrassom, modelo: alta sensibilidade, c, auto-falante, som nítido, componentes: regulador volume, saída p, fone ouvido, tensão alimentação: 110,220 v, frequência: 60 hz

Quantidade: 10,00 Valor Unit.: 400,00 Total Item: 4.000,00

Item: 2 Unidade: unidade Marca: LEPU Modelo: PC

Descrição: Analisador parâmetros equipamento saúde, funções: e simulador de oxímetro de pulso, parâmetros: saturação spo2, ritmo cardíaco, taxa perfusão, frequência: spo2 80 a 100%, 30 a 245 bpm, perfusão 0,2 a 10 %, características adicionais: tela lcd, controle stand alone, adicional 2: portátil, bateria recarregável

Quantidade: 3,00 Valor Unit.: 1.200,00 Total Item: 3.600,00

Item: 3 Unidade: unidade Marca: SAM MEDIC Modelo: SM5004 INALOCLIN

Descrição: Nebulizador, tipo: central min.4 saídas, 4 fluxômetros, filtro, acessórios: 10 cj completos adulto e 10 pediátricos, tensão alimentação: 110,220 v, característica adicionais: compressor isento de óleo, 1,4hp

Quantidade: 7,00 Valor Unit.: 1.490,00 Total Item: 10.430,00

Item: 4 Unidade: unidade Marca: RIESTER Modelo: SCOPE

Descrição: Oftalmoscópio, tipo: aço inox, tipo luz: luz anéfrica, tensão alimentação: 2 pilhas médias v, características adicionais: disco de lentes de +, - 0,5 a +, - 20 dpt, aplicação: diafragma c, 2 tamanhos, componentes: e otoscópio c, cabeça\_c, lâmpada, regulador de luz, adicionais: visor móvel, 5 espelhos reutilizáveis

Quantidade: 22,00 Valor Unit.: 535,00 Total Item: 11.770,00

LOTE 7 Total: R\$ 5.250,00

VALOR TOTAL CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Item: 1 Unidade: unidade Marca: PROLIFE Modelo: PL

Descrição: Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo uso: locomoção possuir apoio (plástico pp) para os pés, individuais articulados, possuir apoio (plástico pp) para o braço, possuir assento em tecido de poliamida (nylon) preto, dobrável em x, possuir encosto em tecido de poliamida (nylon) preto, possuir eixos horizontais das rodas 6 polegadas com deslizamento em buchas, possuir eixos verticais direcionais (garfinhos) com deslizamento em bucha (aço), possuir estrutura tubular em aço carbono 3/4, possuir freios bilaterais tipo esticador, possuir punhos para condução em pvc preto, possuir rodas (plástico pp) direcionais com pneu maciço (pvc) de no mínimo 6 polegadas sendo direcionais atrás, possuir rodas (plástico pp) na frente com pneu maciço (pvc) de 6 polegadas. características adicionais: altura regulável, acessórios: suporte de soro.

Quantidade: 10,00 Valor Unit.: 525,00 Total Item: 5.250,00

LOTE 20 Total: R\$ 110.054,00

VALOR TOTAL CENTO E DEZ MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS

Item: 1 Unidade: unidade Marca: KONDENTECH Modelo: YG100

Descrição: Amalgamador odontológico digital, frequência 60, tensão alimentação bivolt, modelo batedor de cápsula, acabamento liso e arredondado, tempo preparo de 0 30 seg. tipo movimento frequência movimento mínima 4000/elíptica, tamanho universal, modo de operação digital.

Quantidade: 4,00 Valor Unit.: 1.040,00 Total Item: 4.160,00

Item: 2 Unidade: unidade Marca: CLEONICE Modelo: ION PRO X


Descrição: Aparelho de raio x odontológico faixa de tensão kvp 01, instalação de parede, modo de operação analógico. braços arredondados: permite a unificação de peças. equilíbrio dinâmico preciso: permite estender todos os braços em linha reta, sem prejuízo da estabilidade de base. bloqueio contra disparos acidentais, evita disparos consecutivos. controle


Rua DR. PEDRO RANGEL N.577 SALA 05  
ITAJAÍ

BAIRRO SÃO JOÃO


CEP: 88.304-430  
SANTA CATARINA

# Detector Fetal Portátil/Mesa

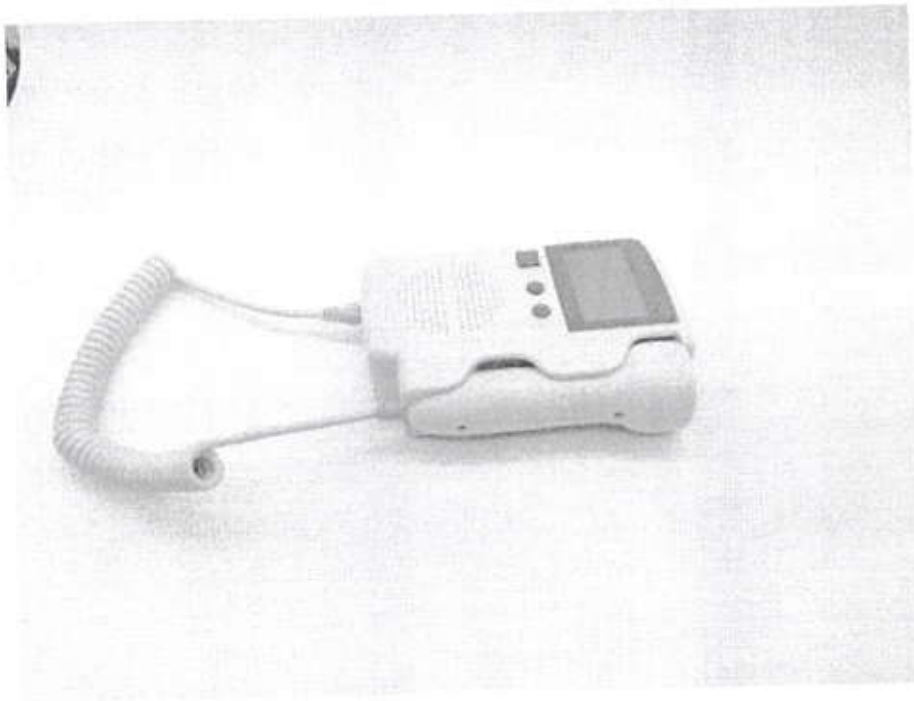

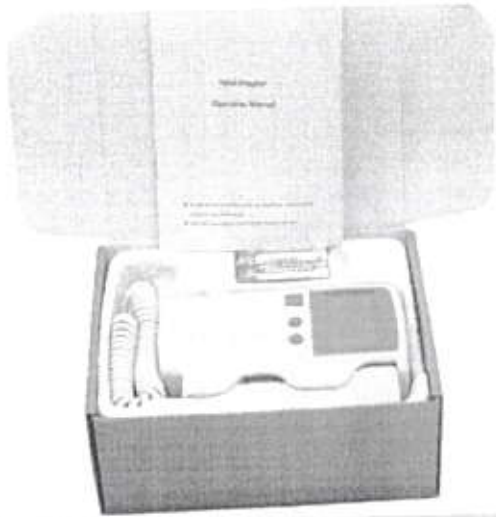



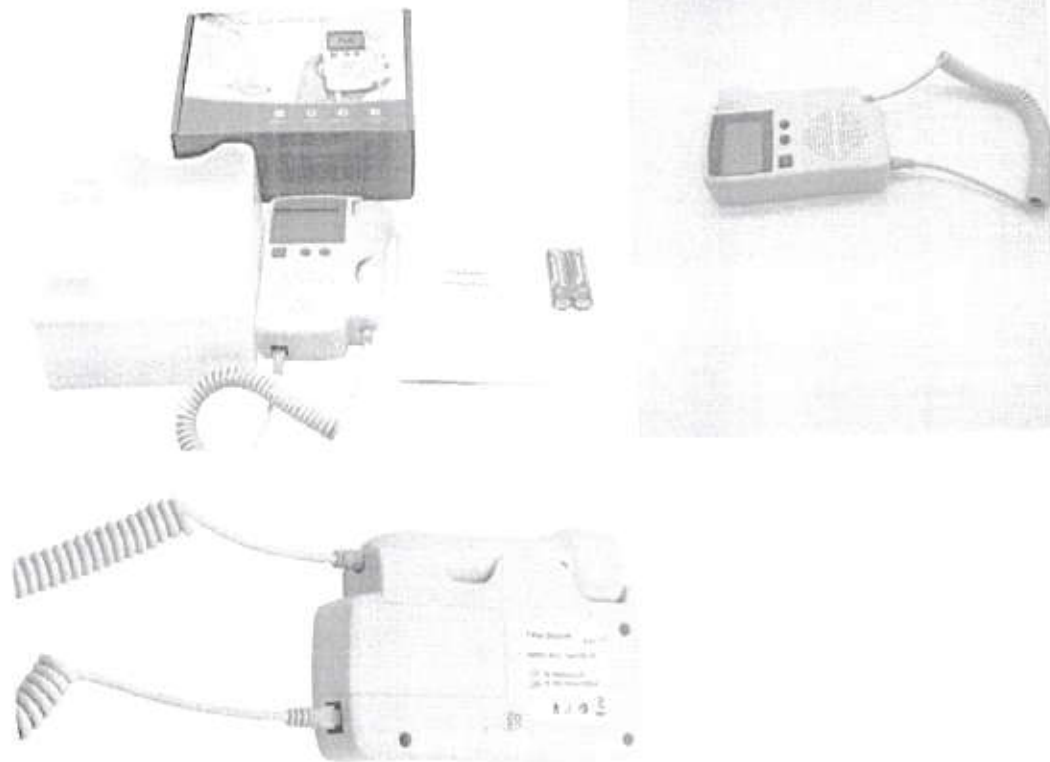

Descrição

## Detalhes

Operação simples e intuitiva;  
Proporciona excelente audição, com som de alta fidelidade;  
Permite audição através do fone de ouvido (fone não incluso) ou alto falante (embutido);  
Transdutor de alta sensibilidade;  
Display de LCD com 45x25 mm ;  
Ergonômico;  
Frequência do ultrassom de 2,5 MHz;  
Ultrassom de baixa intensidade: <math><10\text{mW/cm}^2</math>;  
Faixa de medida do BCF: 50~240bpm;  
Resolução do BCF de 1 bpm;  
Precisão do BCF de  $\pm 2\text{bpm}$ ;  
Acompanha:  
Manual em português

Dados técnicos:

Peso: 100gramas

Temperatura de Trabalho: 05° ~40°C

Umidade: 15~85%

Alimentação: Duas pilhas AA alcalinas ou recarregáveis

Desligamento automático: Sim (após um minuto de inatividade)



\*Acessórios opcionais



ANVISA: 80102519128



## Características

- Exibição da taxa de SpO2, frequência de pulso
- Visualização de PI, onda pleto-gráfica e barra de pulso
- Tecnologia SPO2 anti movimento
- Para pacientes adultos, pediátricos e neonatais
- Bateria de lítium interna recarregável (sem efeito memória), com carregador integrado bivolt automático
- 384 horas de armazenamento de dados SpO2

- Limite de alarme, tons de tecla e nível de tom ajustáveis.
- Alarme audio visual de eletrodo desconectado
- Desligamento automático quando inativo
- Gráfico de tendências de SPO2 e BPM
- Software para comunicação com o PC
- Autonomia da bateria 18 horas

## Especificações técnicas

### SpO2

Cumprimento de onda duplo

Mensuração: 35% - 100%

Acurácia de medição:  $\pm 2\%$  ( para medição de 70% a 100%)

### Taxa de pulso

Medição: 30bpm - 250bpm

Acurácia de medição:  $\pm 2$ bpm ou  $\pm 2\%$

### Índice de Perfusão:

PI: 0,2% - 20%

Armazenamento de dados

Até 384 horas

### Display

2.2 TFT Display

### Opcionais

Outros modelos de sensores

### Fonte de Energia:

Bateria de lítium (opcional Pilhas AA)

### Carregamento

Cabo USB com adaptador

### Dimensões

145 mm x 74 mm x 29 mm

### Peso Líquido

210g

### Armazenamento de dados

Através de Cabo USB

### Acompanha

01 Sensor reutilizável Clip Adulto

Pedestal com cesto e rodízios

# NEBULIZADOR INALOCLIN



## APARELHO DE AEROSOL 04 SAÍDAS

Ecologicamente correto.

MARCA: INALOCLIN

MODELO SAM-5004

REGISTRO ANVISA: 82354539002

FABRICANTE: SAM MEDIC

PRODUTO: NACIONAL

Garantia Fabricante : 1 ano



### Principais Opcionais



Fluxômetro  
de Oxigênio

Válvula reguladora de oxigênio, finalidade fornecer os dados de vazão dos gases em litros por minuto.



Timer Digital

Timer Digital Programável - Temporizador



Régua de impacto  
Tomada de alumínio para multiplicar saídas para oxigenoterapia modelos 1 saída - 4 saídas

### Especificações e Características Técnicas

MOTOR	1/4 (CV)
FLUXO DE AR	28 L/M
GRAU DE PROTEÇÃO	IP21
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127 OU 220V; 127/220V; 127-220V BIVOLT AUTOMÁTICO
MASCARA	KIT DE MICRO NEBULIZAÇÃO COMPLETO
PESO	5 KG
Frequência	60HZ
Dimensão	230 x 500 x 390

- Outros Opcionais
- Manômetro
- fluxômetros
- kits de nebulização completos adulto (compostos por: 01 copinho, 01 mangueira, 01 máscara adulta, 01 máscara)
- kits de nebulização completos infantil (compostos por: 01 copinho, 01 mangueira, 01 máscara adulta, 01 máscara)
- Outros Opcionais – Vide Manual Do Equipamento

SAM MEDIC





Home >> Products >> Instrumentos para ORL, oftalmologia e dermatologia >> ri-scope® L - Instrumentos oftalmológicos e de ORL de topo >> Oftalmoscópios ri-scope® L

## Oftalmoscópios ri-scope® L

### Eficiência ecológica e iluminação e ótica avançadas

ri-scope® L – oftalmoscópios portáteis de topo, com óticas reconhecidas, menor reflexo e tecnologia LED para permitir um diagnóstico mais eficiente com custos de manutenção mais reduzidos. Disponível com iluminação de xénon ou LED e uma grande gama de opções de alimentação.



Product Details | **Accessories** | Downloads

Oftalmoscópios ri-scope®

**ri-scope® L1**

29 lentes: positivas (1-10, 12, 15, 20, 40), negativas (1-10, 15, 20, 25, 30, 35)  
 aberturas: ranhura, estrela de fixação, círculo grande, círculo médio, círculo pequeno, filtro sem vermelho

**ri-scope® L2**

29 lentes, positivas (1-10, 12, 15, 20, 40), negativas (1-10, 15, 20, 25, 30, 35)  
 aberturas: ranhura, estrela de fixação, círculo grande, círculo médio, círculo pequeno, filtro sem vermelho, filtro azul, filtro polarizador

**ri-scope® L3**

59 lentes, positivas (1-45 em incrementos individuais); negativas (1-44 em incrementos individuais)  
 aberturas: grelha, ranhura, estrela de fixação, círculo grande, círculo médio, círculo pequeno, filtro sem vermelho, filtro azul, filtro polarizador  
 dispositivo de focagem para correção rápida de ametropias

**Óticas reconhecidas de alto desempenho e boa iluminação**

- lente condensadora esférica
- Feixes de luz coaxiais para diagnóstico e iluminação (princípio de Gullstrand)
- Vista com redução do reflexo, mesmo com pupilas pequenas

**Desempenho de iluminação do LED de até 150.000 Lux**

**À prova de poeiras**



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

**Nome da Empresa** MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA  
**CNPJ** 66.581.935/0001-17 **Autorização** 8.01.530-3  
**Produto** DOPPLER FETAL DE BOLSO

**Modelo Produto Médico**

SONOLINE B

**Tipo de Arquivo** Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

**Nome Técnico** Sistema Ultra-Sonico "doppler"

**Registro** 80153030105

**Processo** 25351.831662/2016-36

**Fabricante Legal** • FABRICANTE: CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO, LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

**Classificação de Risco** II - MEDIO RISCO

**Vencimento do Registro** VIGENTE

Voltar



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

## Detalhes do Produto

**Nome da Empresa** VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

**CNPJ** 04.718.143/0001-94 **Autorização** 8.01.025-1

**Produto** Oxímetro de Pulso Portátil

## Modelo Produto Médico

PC-66B

## Tipo de Arquivo

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO

## Arquivos

IFU\_80102519128.pdf

## Expediente, data e hora de inclusão

0227132/22-0 - 18/01/2022 - 08:46

**Nome Técnico** Oxímetro de Pulso**Registro** 80102519128**Processo** 25351.035693/2021-35**Fabricante Legal**

- FABRICANTE: LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING ) CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

**Classificação de Risco** II - MEDIO RISCO**Vencimento do Registro** VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ	21.983.850/0001-27
Autorização	8.23.545-3
Produto	nebulizador sam medic - inaloclin

Modelo Produto Médico
sam-5001
sam-5001-c
sam-5002
sam-5002-c
sam-5003
sam-5003-c
sam-5004
sam-5004-c
sam-5005
sam-5005-c
sam-5006
sam-5006-c
sam-5008-c
sam-5010-c

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL FAMÍLIA NEBULIZADOR SAM MEDIC - INALOClin - REV 01.pdf	4290420222 - 13/06/2022 16:08:21

Nome Técnico	Nebulizador
Registro	82354539002
Processo	25351024221202238
Fabricante Legal	SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]

Data de Publicação	[sem dados cadastrados]
--------------------	-------------------------







## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	Halma Saúde e Ótica do Brasil Importação Exportação e Distribuição Ltda
CNPJ	13.640.053/0001-19
Autorização	8.08.916-2
Produto	OFTALMOSCÓPIO RIESTER

Modelo Produto Médico
2076.100 pen-scope oftalmoscópio lâmpada XL 2,5V
3011.100 ri-mini® oftalmoscópio lâmpada XL 2,5 V
2120-200.100 oftalmoscópio e-scope lâmpada à vácuo 2,7V cor branco
2121-200.100 oftalmoscópio e-scope lâmpada à vácuo 2,7V cor preto
2122-201.100 oftalmoscópio e-scope lâmpada XL 2.5 V, cor branco
2123-201.100 oftalmoscópio e-scope lâmpada XL 2.5 V, cor preto
2122-203.100 oftalmoscópio e-scope lâmpada LED 3.7 V cor branco
2123-203.100 oftalmoscópio e-scope lâmpada LED 3.7 V cor preto
10568.100 Oftalmoscópio ri-scope L1 XL 2,5V
10569.100 Oftalmoscópio ri-scope L1 XL 3,5V
10568-301.100 Oftalmoscópio ri-scope L1 lâmpada XL 2,5V com sistema anti-furto
10569-301.100 Oftalmoscópio ri-scope L1 lâmpada XL 3,5V com sistema anti-furto
10594-301.100 Oftalmoscópio ri-scope L1 lâmpada LED 3,5V com com sistema anti-furto
10569-203.100 Oftalmoscópio ri-scope L1 lâmpada XL 3,5V com com sistema anti-furto
10570.100 Oftalmoscópio ri-scope L2 lâmpada XL 2,5V
10571.100 Oftalmoscópio ri-scope L2 lâmpada XL 3,5V
10570-301.100 Oftalmoscópio ri-scope L2 lâmpada XL 2,5V com sistema anti-furto
10571-301.100 Oftalmoscópio ri-scope L2 lâmpada XL 3,5V com sistema anti-furto
10595-301.100 Oftalmoscópio ri-scope L2 lâmpada LED 3,5V com sistema anti-furto
10571-203.100 Oftalmoscópio ri-scope L2 lâmpada LED 3,5V
10572.100 Oftalmoscópio ri-scope L3 lâmpada XL 2,5V
10573.100 Oftalmoscópio ri-scope L3 lâmpada XL 3,5V
10572-301.100 Oftalmoscópio ri-scope L3 lâmpada XL 2,5V com sistema anti-furto
10573-301.100 Oftalmoscópio ri-scope L3 lâmpada XL 3,5V com sistema anti-furto
10573-203.100 Oftalmoscópio ri-scope L3 lâmpada LED 3,5V
10596-301.100 Oftalmoscópio ri-scope L3 lâmpada LED 3,5V com sistema antifurto



INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso Oftalmo Riester Direto 80891620015.pdf	4133313208 - 23/11/2020 17:18:34

Nome Técnico	Oftalmoscópio
Registro	80891620015
Processo	25351602290201372
Fabricante Legal	RUDOLF RIESTER GMBH
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]



Aracati, 03 de julho de 2024

OFÍCIO Nº 0307.02/2024

Excelentíssima Senhora CRISTIANE ARAÚJO VIEIRA ALVES, Secretária de saúde do Município de Aracati.

Pelo Presente, vimos encaminhar para esta Secretaria o Recurso Administrativo da empresa **ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**, sobre questionamentos referente aos itens **6.2** e **6.4** do lote 6, da proposta da empresa vencedora do Pregão Eletrônico nº 10.003-2024/SRP, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE. Segue questionamento** "E ainda, o equipamento ofertado para o item 6.4 do lote 06, o licitante não demonstrou o atendimento do equipamento ao solicitado, devido a ter registrado em sua proposta apenas "modelo Scope", e o fabricante possui modelos "Pen-Scope" e "E-Scope", os quais possuem características distintas, o mesmo, se aplica ao item 6.2, onde o licitante informou modelo "PC", que o fabricante, possui PC-66B, PC-900, PC-303, entre outros, logo, a comissão não tem como identificar qual equipamento será entregue ao Município pelo licitante, qualquer um destes será o que o mesmo constou parcialmente em sua proposta. Logo o equipamento ofertado pelo licitante, classificado em primeiro, não atende ao contido em edital, sendo este inferior ao solicitado e o licitante não atendeu com a apresentação de todos os documentos de habilitação previstos em edital". Foi solicitado da empresa vencedora catálogo com a descrição dos itens a serem entregues. Segue em anexo a proposta vencedora, recurso administrativo e catálogo da empresa declarada vencedora do lote. Como se trata de entendimento técnico, solicito que a secretária e/ou alguém do quadro técnico da secretaria emita um documento nos respondendo se os itens ofertados atendem ou não o Termo de referência.

Sem mais, elevo o meu voto de estima e consideração.

Nataniele Rodrigues Gondim

Pregoeira da Secretaria de Licitações e Contratos Administrativos

## PE 10.003-2024/SRP - Questionamento descritivo de item

1 mensagem

nataniele.gondim <nataniele.gondim@aracati.ce.gov.br>  
Para: fsaudearacati@aracati.ce.gov.br

3 de julho de 2024 às 16:45

Boa tarde, segue em anexo ofício solicitando que a Secretaria nos responda se os questionamentos levantados no recurso tem procedência ou não.

Em anexo: Proposta do lote 6; recurso administrativo e catálogo da empresa.

Grata!



### 4 anexos

-  **IMG\_0003.pdf**  
1890K
-  **recurso administrativo.pdf**  
1123K
-  **Doc1.docx**  
915K
-  **Ficha.CATÁLOGOS LT06.ARACATI.pdf**  
1418K



Of. N. 178/2024/SMS

Aracati, 11 de julho de 2024.

A Senhor,  
Nataniele Gondim Rodrigues  
Pregoeira do Município do Aracati

**Assunto:** Esclarecimentos referentes ao pregão eletrônico nº 10.003-2024/SRP.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste fornecer os esclarecimentos solicitados, em resposta às perguntas encaminhadas por e-mail a esta Secretaria, relativas ao Pregão Eletrônico nº 10.005/2024:

Item 6.2 – “Modelo PC”

Recurso:

A empresa Asclépio questiona as especificações técnicas do item 6.2, modelo “PC”.

Descrição/Especificação Técnica do Item Licitado: ANALISADOR PARÂMETROS EQUIPAMENTO SAÚDE, FUNÇÕES: E SIMULADOR DE OXÍMETRO DE PULSO, PARÂMETROS: SATURAÇÃO SPO2, RITMO CARDÍACO, TAXA PERFUSÃO, FREQUÊNCIA: SPO2 80 A 100%, 30 A 245 BPM, PERFUSÃO 0,2 A 10 %, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TELA LCD, CONTROLE STAND ALONE, ADICIONAL 2: PORTÁTIL, BATERIA RECARREGÁVEL.

Especificações Técnicas do Catálogo de Itens do Lote 6:

Modelo: OXÍMETRO DE PULSO PC-66B

Exibição da taxa de SPO2

SPO2: Acurácia de Medição:  $\pm 2\%$  (para medição de 70% a 100%)

Taxa de Pulso: Medição: 30BPM ~250BPM

PI: 0.2% ~20%

Características Adicionais: Bateria de Lithium (opcional pilhas AA), Tela de LCD, 01 Sensor Reutilizável Clip Adulto.

Conclusão: Conforme análise das especificações técnicas do catálogo de itens referente à proposta do lote 6, item 6.2, todas as características estabelecidas no item, necessárias ao desempenho de suas funções, são atendidas. Portanto, a proposta cumpre com os requisitos técnicos exigidos no edital.

Item 6.4 – “Modelo Scope”

Recurso:

A empresa Asclépio questiona as especificações técnicas do item 6.4, modelo “Scope”.

Descrição/Especificação Técnica do Item Licitado: OFTALMOSCÓPIO, TIPO: AÇO INOX, TIPO LUZ: LUZ ANÉTRICA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS MÉDIAS V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISCO DE LENTES DE +, - 0,5 A +, - 20 DPT, APLICAÇÃO: DIAFRAGMA C, 2 TAMANHOS, COMPONENTES: E OTOSCÓPIC C, CABEÇA C, LÂMPADA, REGULADOR DE LUZ, ADICIONAIS: VISOR MÓVEL, 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS.




Especificações Técnicas do Catálogo de Itens do Lote 6:

Oftalmoscópio: Lâmpada de xênon 2,5V, regulador de luz, lentes de 0 a +20 e de 0 a -20 dioptrias, Display iluminado, quatro aberturas, acompanha 10 espelhos reutilizáveis, estrutura em aço, alimentação por duas pilhas.

Conclusão: Conforme análise das especificações técnicas do catálogo de itens referente à proposta do lote 6, item 6.4, e explicações do fornecedor, todas as características estabelecidas no item, necessárias ao desempenho de suas funções, são atendidas.

Atenciosamente,



---

Cristiane Araújo Vieira Alves  
Secretária da Saúde do Aracati



\*Acessórios opcionais



ANVISA: 80102519128



## Características

- Exibição da taxa de SpO2, frequência de pulso
- Visualização de PI, onda pletoisomográfica e barra de pulso
- Tecnologia SPO2 anti movimento
- Para pacientes adultos, pediátricos e neonatais
- Bateria de lítium interna recarregável (sem efeito memória), com carregador integrado bivolt automático
- 384 horas de armazenamento de dados SpO2

- Limite de alarme, tons de tecla e nível de tom ajustáveis.
- Alarme audio visual de eletrodo desconectado
- Desligamento automático quando inativo
- Gráfico de tendências de SPO2 e BPM
- Software para comunicação com o PC
- Autonomia da bateria 18 horas

## Especificações técnicas

### SpO2

Cumprimento de onda duplo

Mensuração: 35% ~100%

Acurácia de medição:  $\pm 2\%$  ( para medição de 70% a 100%)

### Taxa de pulso

Medição: 30bpm ~250bpm

Acurácia de medição:  $\pm 2$ bpm ou  $\pm 2\%$

### Índice de Perfusão:

PI: 0.2% ~20%

Armazenamento de dados

Até 384 horas

### Display

2.2 TFT Display

### Opcionais

Outros modelos de sensores

### Fonte de Energia:

Bateria de lítium (opcional Pilhas AA)

### Carregamento

Cabo USB com adaptador

### Dimensões

145 mm x 74 mm x 29 mm

### Peso Líquido

210g

### Armazenamento de dados

Através de Cabo USB

### Acompanha

01 Sensor reutilizável Clip Adulto

Pedestal com cesto e rodízios

ri-mini®



## Otoscópios, Oftalmoscópios de Bolso



01 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

### Otoscópio

Lâmpada de xênon 2,5V, estrutura em plástico rígido reforçado com fibra de vidro, transmissão da luz através de fibra óptica, lente de aumento 2,5 vezes, sistema selado para otoscopia pneumática, lente removível para instrumentação, cabo de metal cromado resistente à corrosão.

Acompanha 10 espéculos reutilizáveis e autoclaváveis, 2 de cada tamanho: 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm e 5mm.

### Código

3010.100 ri-mini® otoscópio XL 2,5V, preto

### Oftalmoscópio

Sistema de encaixe rápido e seguro no cabo. Altamente resistente à impactos. Estrutura em plástico rígido reforçado com fibra de vidro. Lâmpada fácil de trocar na base do instrumento em 2,5V. Lentes de 0 a +20 e de 0 a -20 dioptrias. Display iluminado, protetor para não arranhar a lente dos óculos. Quatro aberturas: círculo pequeno, semi-círculo, círculo grande e fixação, e um filtro verde.

### Código

3011.100 ri-mini® oftalmoscópio XL 2,5 V, preto

2 anos de garantia.

pen-scope®



01 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

### Otoscópio pen-scope

Agora com lâmpada 2,7 V a vácuo, lente de aumento 2,5 vezes, sistema selado para otoscopia pneumática, lente removível para instrumentação. Estrutura em plástico rígido reforçado com fibra de vidro. Acompanha 10 espéculos reutilizáveis e autoclaváveis, 2 de cada tamanho: 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm e 5mm.

### Código

2056-200.100 pen-scope® otoscópio 2,7 V a vácuo, preto.

### Oftalmoscópio pen-scope

Possui agora lâmpada em xênon de 2,5 V XL. Lentes de 0 a +20 e de 0 a -20, display de dioptrias iluminado, proteção para os óculos, quatro aberturas (círculo pequeno, semi-círculo, círculo grande e fixação). Estrutura em plástico rígido reforçado com fibra de vidro.

### Código

2076.100 pen-scope® oftalmoscópio 2,5 V XL, preto, em bolsa.

2 anos de garantia.





Aracati, 03 de julho de 2024

OFÍCIO Nº 0307.02/2024


Excelentíssima Senhora CRISTIANE ARAÚJO VIEIRA ALVES, Secretária de saúde do Município de Aracati.

Pelo Presente, vimos encaminhar para esta Secretaria o Recurso Administrativo da empresa **ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**, sobre questionamentos referente aos itens **6.2** e **6.4** do lote 6, da proposta da empresa vencedora do Pregão Eletrônico nº 10.003-2024/SRP, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE. Segue questionamento** "E ainda, o equipamento ofertado para o item 6.4 do lote 06, o licitante não demonstrou o atendimento do equipamento ao solicitado, devido a ter registrado em sua proposta apenas "modelo Scope", e o fabricante possui modelos "Pen-Scope" e "E-Scope", os quais possuem características distintas, o mesmo, se aplica ao item 6.2, onde o licitante informou modelo "PC", que o fabricante, possui PC-66B, PC-900, PC-303, entre outros, logo, a comissão não tem como identificar qual equipamento será entregue ao Município pelo licitante, qualquer um destes será o que o mesmo constou parcialmente em sua proposta. Logo o equipamento ofertado pelo licitante, classificado em primeiro, não atende ao contido em edital, sendo este inferior ao solicitado e o licitante não atendeu com a apresentação de todos os documentos de habilitação previstos em edital". Foi solicitado da empresa vencedora catálogo com a descrição dos itens a serem entregues. Segue em anexo a proposta vencedora, recurso administrativo e catálogo da empresa declarada vencedora do lote. Como se trata de entendimento técnico, solicito que a secretária e/ou alguém do quadro técnico da secretaria emita um documento nos respondendo se os itens ofertados atendem ou não o Termo de referência.

Sem mais, elevo o meu voto de estima e consideração.

Nataniele Rodrigues Gondim

Pregoeira da Secretaria de Licitações e Contratos Administrativos

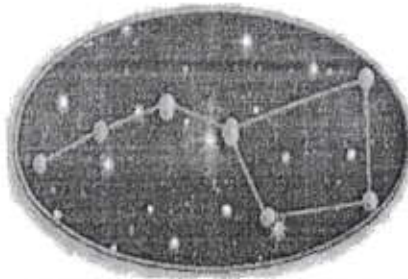**URSA COMERCIAL****URSA COMERCIAL LTDA.**

Equipamentos Médicos e ortopédicos

CNPJ 26.628.908/0001-38

INSC: 261.473.352

E-mail: [ursaltda@gmail.com](mailto:ursaltda@gmail.com)

Telefone 47 9163-2802



oferece melhor acabamento e resistência estrutural ao conjunto. encosto oscilante, com movimentos reguláveis de afastamento e aproximação e longitudinal para apoio renal. assento com estofamento pouco espesso e bem consistente, formato anatômico com borda da frente arredondada e encurvada para baixo evita compressão de artérias, veias, nervos e tendões de músculos; totalmente sem costura ou emendas de fácil limpeza e desinfecção. altura do assento máxima de 540mm, mínima de 440mm. estofamento de cores suaves que dão maior integração com outros componentes do consultório.

Quantidade: 1,00	Valor Unit.: 404,00	Total Item: 404,00
------------------	---------------------	--------------------

LOTE 6	Total: R\$ 29.800,00		
VALOR TOTAL VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS			
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: CONTEC	Modelo: SB
Descrição: Doppler, tipo: sonnar portátil, elétrico, ausculta bcf por ultrassom, modelo: alta sensibilidade, c, auto-falante, som nítido, componentes: regulador volume, saída p, fone ouvido, tensão alimentação: 110,220 v, frequência: 60 hz			
Quantidade: 10,00	Valor Unit.: 400,00	Total Item: 4.000,00	
Item: 2	Unidade: unidade	Marca: LEPU	Modelo: PC
Descrição: Analisador parâmetros equipamento saúde, funções: e simulador de oxímetro de pulso, parâmetros: saturação spo2, ritmo cardíaco, taxa perfusão, frequência: spo2 80 a 100%, 30 a 245 bpm, perfusão 0,2 a 10 %, características adicionais: tela lcd, controle stand alone, adicional 2: portátil, bateria recarregável			
Quantidade: 3,00	Valor Unit.: 1.200,00	Total Item: 3.600,00	
Item: 3	Unidade: unidade	Marca: SAM MEDIC	Modelo: SM5004 INALOCLIN
Descrição: Nebulizador, tipo: central mín.4 saídas, 4 fluxômetros, filtro, acessórios: 10 cj completos adulto e 10 pediátricos, tensão alimentação: 110,220 v, característica adicionais: compressor isento de óleo, 1,4hp			
Quantidade: 7,00	Valor Unit.: 1.490,00	Total Item: 10.430,00	
Item: 4	Unidade: unidade	Marca: RIESTER	Modelo: SCOPE
Descrição: Oftalmoscópio, tipo: aço inox, tipo luz: luz anêtrica, tensão alimentação: 2 pilhas médias v, características adicionais: disco de lentes de +, - 0,5 a +, - 20 dpt, aplicação: diafragma c, 2 tamanhos, componentes: e otoscópio c, cabeça_c, lâmpada, regulador de luz, adicionais: visor móvel, 5 espéculos reutilizáveis			
Quantidade: 22,00	Valor Unit.: 535,00	Total Item: 11.770,00	

LOTE 7	Total: R\$ 5.250,00		
VALOR TOTAL CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS			
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PROLIFE	Modelo: PL
Descrição: Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo uso: locomoção possuir apoio (plástico pp) para os pés, individuais articulados, possuir apoio (plástico pp) para o braço, possuir assento em tecido de poliamida (nylon) preto, dobrável em x, possuir encosto em tecido de poliamida (nylon) preto, possuir eixos horizontais das rodas 6 polegadas com deslizamento em buchas, possuir eixos verticais direcionais (garfinhos) com deslizamento em bucha (aço), possuir estrutura tubular em aço carbono 3/4, possuir freios bilaterais tipo esticador, possuir punhos para condução em pvc preto, possuir rodas (plástico pp) direcionais com pneu maciço (pvc) de no mínimo 6 polegadas sendo direcionais atrás, possuir rodas (plástico pp) na frente com pneu maciço (pvc) de 6 polegadas. características adicionais: altura regulável, acessórios: suporte de soro.			
Quantidade: 10,00	Valor Unit.: 525,00	Total Item: 5.250,00	

LOTE 20	Total: R\$ 110.054,00		
VALOR TOTAL CENTO E DEZ MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS			
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: KONDETECH	Modelo: YG100
Descrição: Amalgamador odontológico digital, frequência 60, tensão alimentação bivolt, modelo bater de cápsula, acabamento liso e arredondado, tempo preparo de 0 30 seg. tipo movimento frequência movimento mínima 4000/eliptcia, tamanho universal, modo de operação digital.			
Quantidade: 4,00	Valor Unit.: 1.040,00	Total Item: 4.160,00	
Item: 2	Unidade: unidade	Marca: CLEONICE	Modelo: ION PRO X
Descrição: Aparelho de raio x odontológico faixa de tensão kvp 01, instalação de parede, modo de operação analógico. braços arredondados: permite a unificação de peças. equilíbrio dinâmico preciso: permite estender todos os braços em linha reta, sem prejuízo da estabilidade de base. bloqueio contra disparos acidentais, evita disparos consecutivos. controle			

Rua DR. PEDRO RANGEL N.577 SALA 05  
ITAJAÍ

BAIRRO SÃO JOÃO

CEP: 88.304-430  
SANTA CATARINA