



PROPOSTA FINANCEIRA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE
PREGÃO ELETRÔNICO - PE N 10.005/2024
ABERTURA: - 09 DE JULHO ÀS 08:30:00

A empresa LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSP LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 05.652.247/0001-06 - I.E 636281938114 com sede localizada na Av. GUIDO ALIBERTI, nº3005 Bairro JARDIM SAO CAETANO, Município de Sao Caetano do Sul, Estado de SP, CEP 09.581-680, por seu representante abaixo assinado, declara que na Proposta comercial abaixo estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, todas as despesas e custos, tais como: transporte (inclusive frete), seguro contra todos os riscos existentes, garantia e tributos de qualquer natureza, sendo que aqueles que não forem transcritos, serão considerados como já constantes.

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ITEM R\$
G1	1	<p>Locação de 35 (trinta e cinco) Concentradores de oxigênio: Fluxo variável de 0 a 5L/ min (cinco litros por minuto) filtros para remoção de poeira Locação de 35 (trinta e cinco) Concentradores de oxigênio: Fluxo variável de 0 a 5L/ min (cinco litros por minuto) filtros para remoção de poeira, bactérias e outras partículas, sistema de alarme para indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio forra dos parâmetros normais de operações, móvel montado sobre rodízios, alimentação elétrica de 220 v/60hz. Incluso cânula nasal com extensor e copo umidificador, com manutenção preventiva e corretiva e reposição de peças com assistência técnica 24horas</p> <p>CONCENTRADOR MERCURY MARCA/ FABRICANTE LHB ANVISA 80488299007</p> <p>CATETER NASAL MARCA LHB / FABRICANTE HANGZHOU SUPERDS ANVISA 80488290011</p> <p>EXTENSÃO MARCA LHB /FABRICANTE ENTER MEDICAL ANVISA 80488290005</p> <p>OXIGÊNIO MARCA LHB (DISPENSA RMS)</p>	Serviços	12	7.000,00	84.000,00






		<p>CILINDRO MARCAMATT – (DISPENSA RMS) FLUXOMETRO E VALVULAS REGULADORAS PARA CILINDROS MARCA LHB/ FABRICANTE JG MORIYA ANVISA 10349590102)</p> <p>COPO UMIDIFICADOR MARCA/FABRICANTE: PROTEC ANVISA 80435140016</p>				
G1	2	<p>Locação de 10 (dez) Concentradores de oxigênio: Fluxo variável de 0 a 10L/ min (dez litros por minuto) filtros para remoção de poeira Locação de 10 (dez) Concentradores de oxigênio: Fluxo variável de 0 a 10L/ min (dez litros por minuto) filtros para remoção de poeira, bactérias e outras partículas, sistema de alarme para indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio forra dos parâmetros normais de operações, móvel montado sobre rodízios, alimentação elétrica de 220 v/60hz. Incluso cânula nasal com extensor e copo umidificador, com manutenção preventiva e corretiva e reposição de peças com assistência técnica 24horas.</p> <p>CONCENTRADOR GRAN MERCURY MARCA/ FABRICANTE LHB ANVISA 80488290037</p> <p>CATETER NASAL MARCA LHB / FABRICANTE HANGZHOU SUPERDS ANVISA 80488290011</p> <p>EXTENSÃO MARCA LHB /FABRICANTE ENTER MEDICAL ANVISA 80488290005</p> <p>OXIGÊNIO MARCA LUMIAR (DISPENSA RMS) CILINDRO MARCAMATT – (DISPENSA RMS)</p> <p>FLUXOMETRO E VALVULAS REGULADORAS PARA CILINDROS MARCA LHB/ FABRICANTE JG MORIYA</p>	Serviços	12	3.500,00	42.000,00





		(ANVISA 10349590102 COPO UMIDIFICADOR MARCA/FABRICANTE: PROTEC ANVISA 80435140016				
G1	3	<p>Locação de 2 (dois) aparelhos CPAP Auto com umidificação - Características: Aparelho de Ventilação não invasiva CPAP. Especificação: Pressões de Terapia de no mínimo 4 a 20 cm H2O</p> <p>Locação de 2 (dois) aparelhos CPAP Auto com umidificação - Características: Aparelho de Ventilação não invasiva CPAP. Especificação: Pressões de Terapia de no mínimo 4 a 20 cm H2O, podendo estar no modo AUTO realizando automaticamente as mudanças de pressões conforme as necessidades do paciente; alívio de pressão na expiração, proporcionando ao paciente um maior conforto e fácil adaptação ao tratamento; Painel de controle com display digital de cristal líquido que permita a fácil visualização das funções, mesmo a noite, e a verificação da pressão de terapia; SoftStart (Stand By)- entrega a pressão de terapia somente após a colocação da máscara no rosto, resultando em pressões iniciais mais confortáveis e suaves; Vent Ramp: rampa com tempos ajustáveis de no mínimo 0 – 20 min. Permitir adequar um início de terapia mais confortável com pressões menores. Tolerância a vazamentos: permitir identificar e compensar automaticamente a vazamentos, mantendo sempre as pressões de terapia estáveis e constantes. Ajuste automático de altitude mantendo pressões de terapia calibradas e precisas mesmo em altitudes diferentes sem comprometimento do resultado da terapia; Rede 110/220 v automática, com ampla faixa voltagem (100 -240 v) e bi frequencial (50 – 60Hz); Funcionamento em 12- 24V DC; Memória interna mínima de 06 meses para análise dos dados e monitorização da progressão da terapia do paciente; Cartão smart card para registro de data, horário e duração de cada sessão, fuga, índice de apnéia/hipopnéia e ronco, possibilitando a emissão de relatórios sobre estes dados para</p>	Serviços	12	400,00	4.800,00

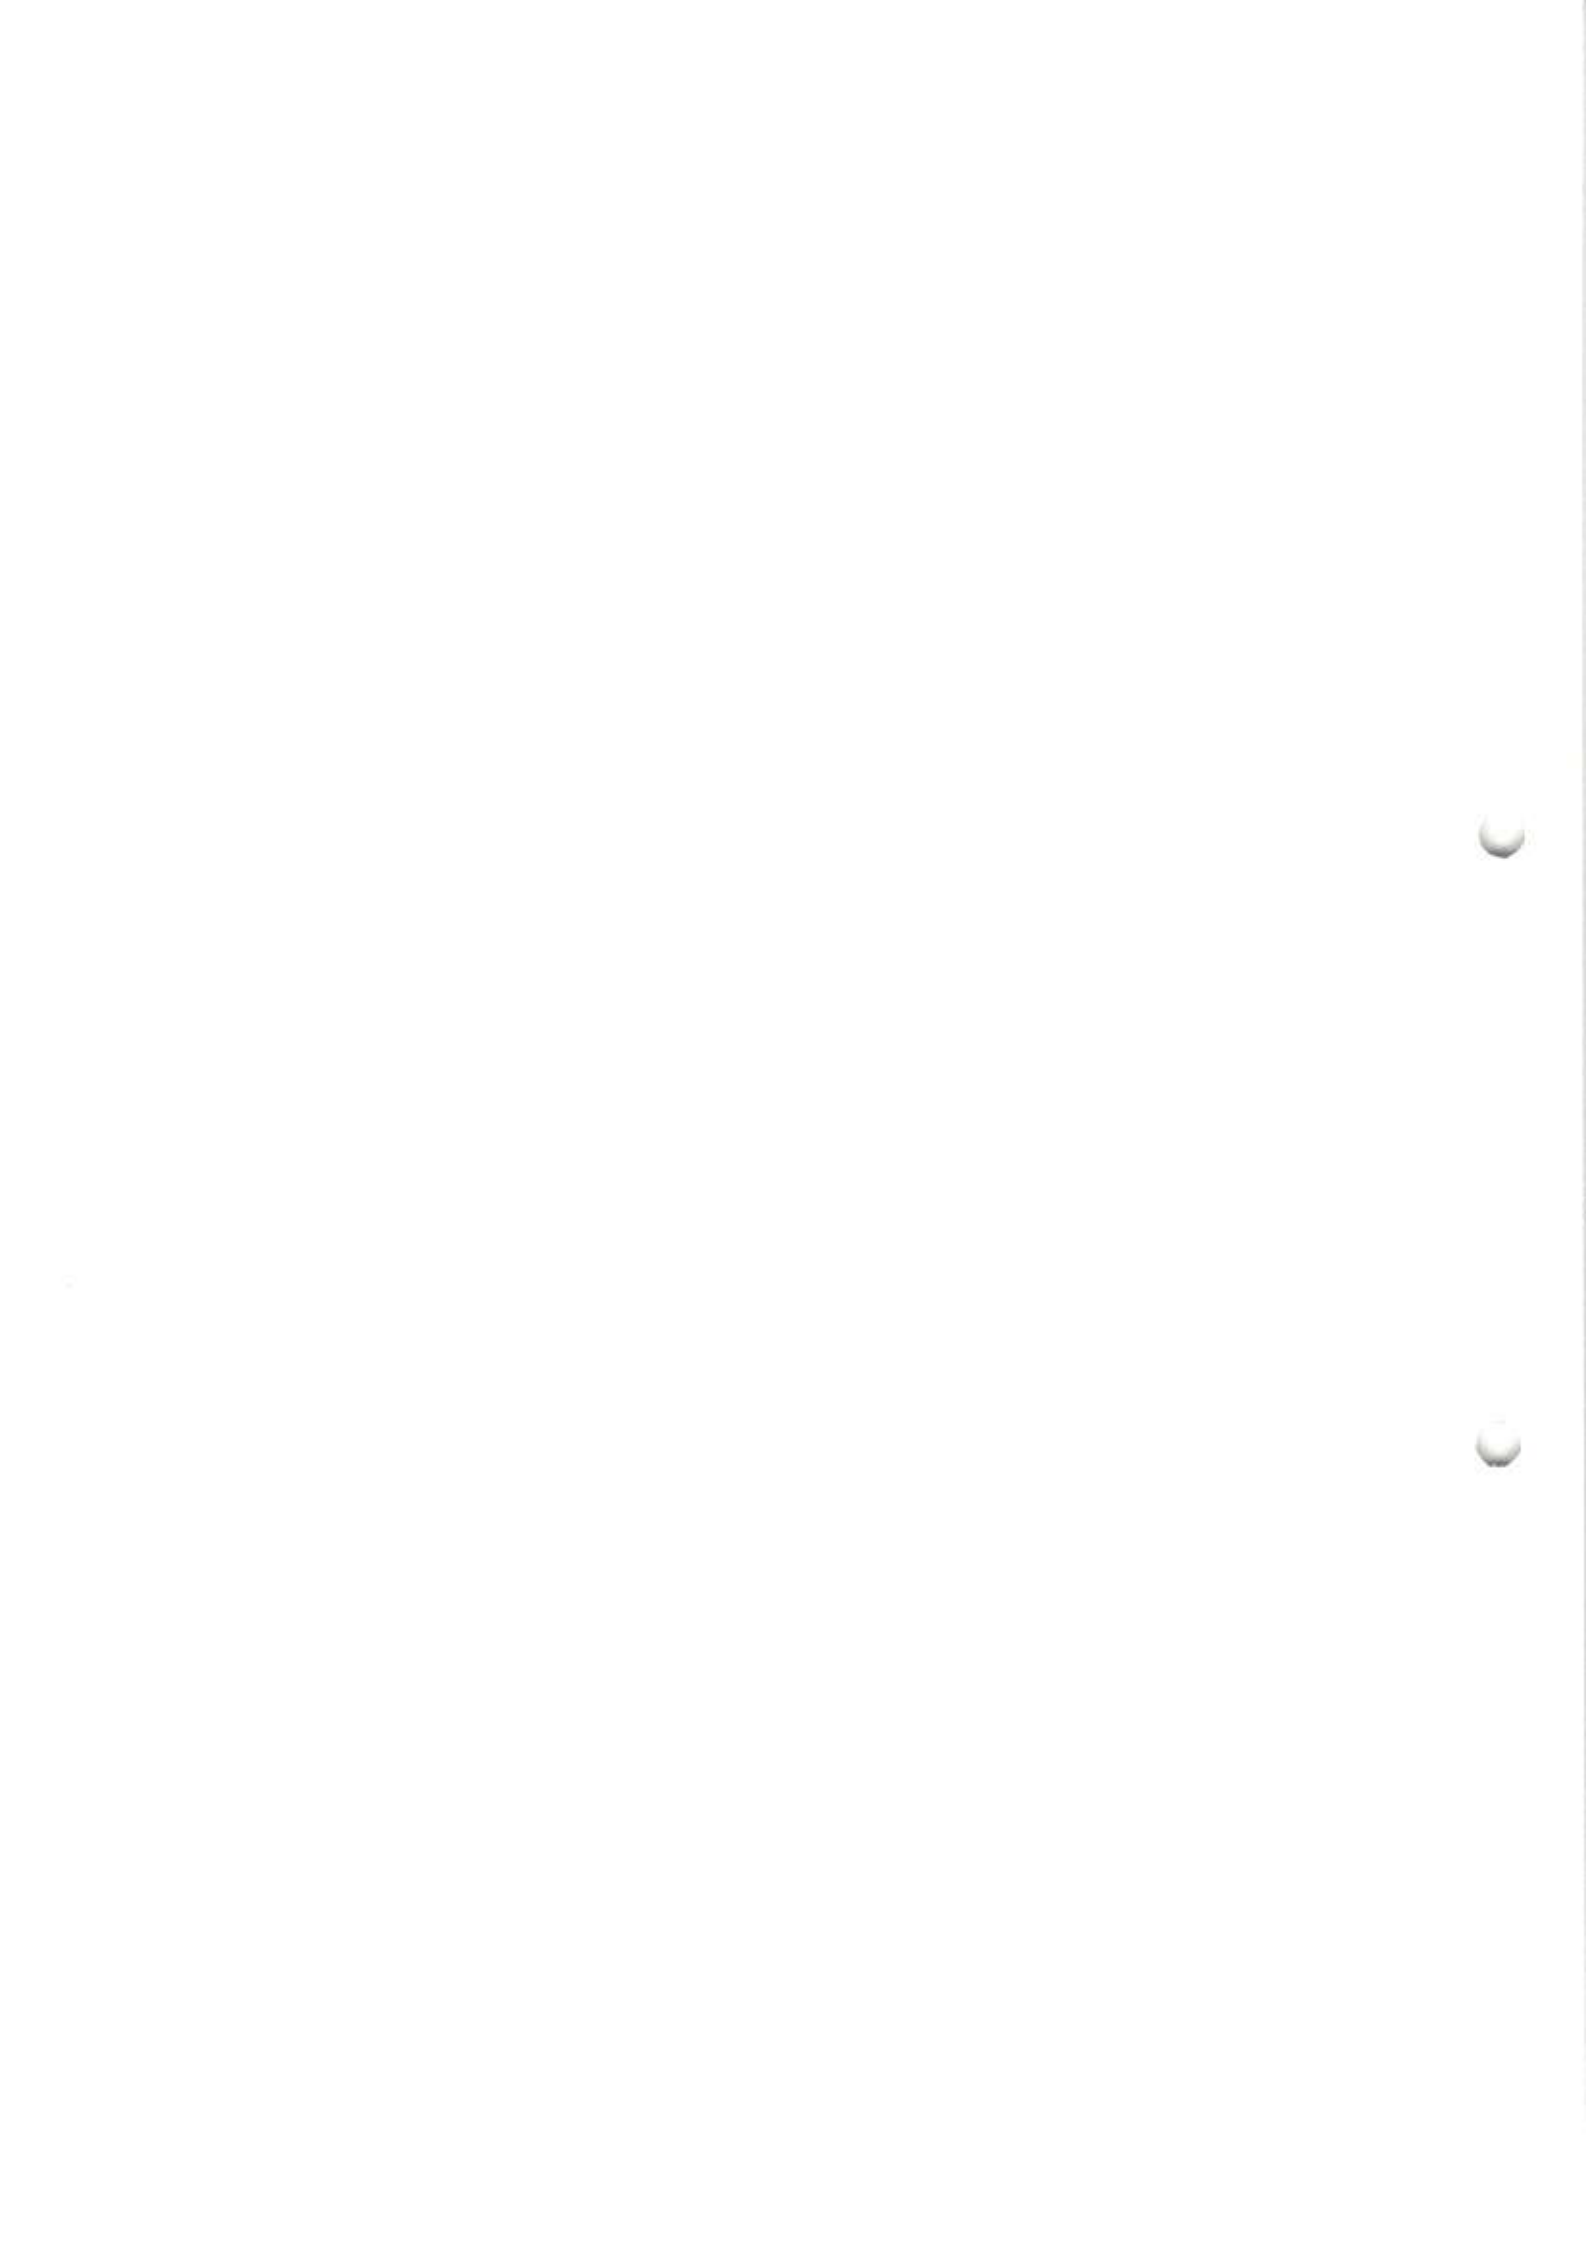



	<p>auxílio na avaliação médica. Calibração sem necessidade de manômetro; Segurança: Deverá acionar um alarme sonoro toda vez que identificar uma condição de falha de energia elétrica ou desconexão do paciente; Função de bloqueio do painel de controle que impede a desconfiguração dos parâmetros do CPAP; Memória interna para armazenamento de códigos de erro de funcionamento; Qualidade e durabilidade certificados; Para cada equipamento devem acompanhar no mínimo os seguintes acessórios: Mascara nasal ou facial com fixador cefálico: Circuito não invasivo em silicone ou PVC com extensão de 1,80 metros. Umidificador Acoplável para umidificação e aquecimento do ar recebido durante a terapia com modo de ajuste de temperatura em 05 níveis redesenha com câmara de água escondida oferecendo umidificação contínua durante toda a noite e sensor de temperatura ambiente</p> <p>CPAP AUTO G3 A20 COM UMIDIFICADOR INTEGRADO ANVISA: 81464750049 MARCA/FABRICANTE BMC</p> <p>MASCARA NASAL N5BMC ANVISA 80117580216 FABRICANTE /MARCA: BMC</p> <p>OU MASCARA FACIAL F2BMC ANVISA 80117580216 FABRICANTE /MARCA: BMC</p> <p>CIRCUITO NÃO INVASIVO MARCA / FABRICANTE: LHB - BRASIL RMS 80488290032 FABRICANTE: SERVICIO</p>				
--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 130.800,00 (CENTO E TRINTA MIL E OITOCENTOS REAIS)



Validade da proposta: 90 dias
Prazo de entrega: 24 horas após solicitação
Pagamento: 30 dias



Declaramos que:

Temos o pleno conhecimento, aceitação e cumpriremos todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência deste edital.

Estão inclusos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros, tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ ou qualquer infração.

Seguros em geral. Da infortúnica e de responsabilidade civil para qualquer dano e prejuízo causado. À Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO / ATA DE REGISTRO

Nome do responsável pela assinatura do contrato: **Alexsandra Ciotta Mani**

E-mail para envio de contrato: alexsandra.mani@lumiarsaude.com.br

E-mail Pessoal: ale.ciotta@hotmail.com

Telefone para contato: Celular: (13)99174-1152 - Telefone/Fax: (11) 3775-0732

Profissão: Fisioterapeuta Cargo na empresa: Gerente de Licitações

CPF: 222.421.438-32 RG: 34.971.911-1

Data de nascimento: 13/09/1981

Endereço: Rua Napoleão Laureano nº124 - Apto 51 - Santos/SP

Estado Civil: Casada Nacionalidade: Brasileira

Outorga por meio de: Procuração (x) Contrato Social ()

Dados bancários:

AG 0591-6 (VILA GERTI SC.SUL)

CC 83001-1

Banco do Brasil Agência 0322-0 (SÃO CAETANO)

CC 101390-4

São Caetano do Sul, 09 de JULHO de 2024



Documento assinado digitalmente
ALEXSANDRA CIOTTA MANI
Data: 09/07/2024 10:36:49-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Alexsandra Ciotta Mani
Gerente de Licitações
RG: 34.971.911-1
CPF: 222.421.438-32

05.652.247/0001-067
LUMIAR HEALTH BULCARG
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Av. Guido Aliberti, 3005
At. São Camano - CEP: 05681-400
São Caetano do Sul - SP





